Pile Dynamics, Inc.

Transducer 895W

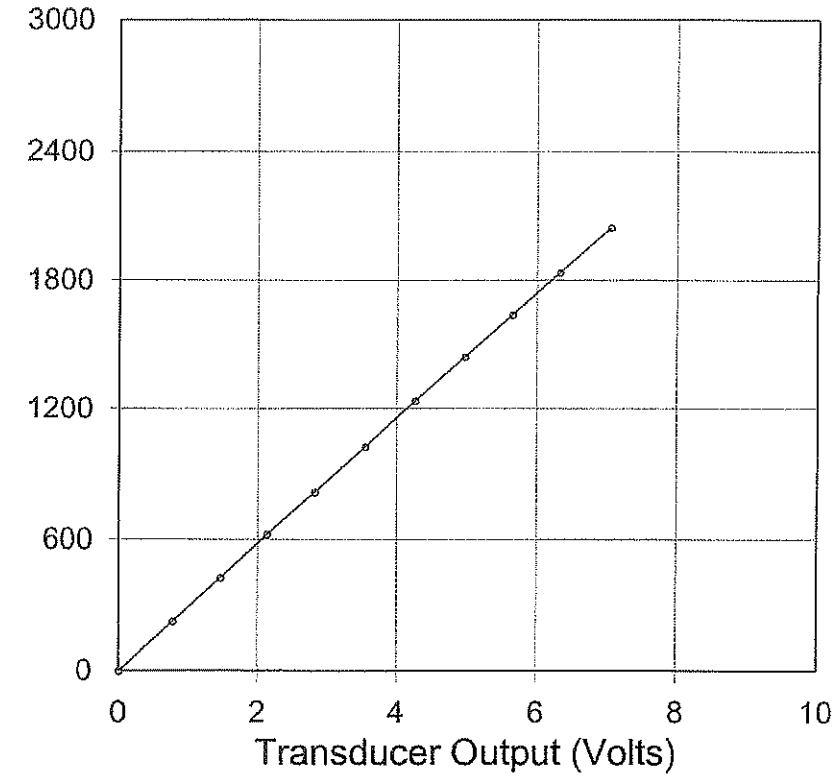

PDA Cal Factor (5.0 V) 145.0με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
228	0.77
427	1.46
623	2.13
814	2.82
1022	3.54
1234	4.25
1441	4.96
1638	5.64
1836	6.32
2046	7.05

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 503.4με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: [signature]

Calibrated on: 15-Mar-2010

Strain Transducer Calibrator System 2009 Version 1.3