Pile Dynamics, Inc.

Transducer 896W

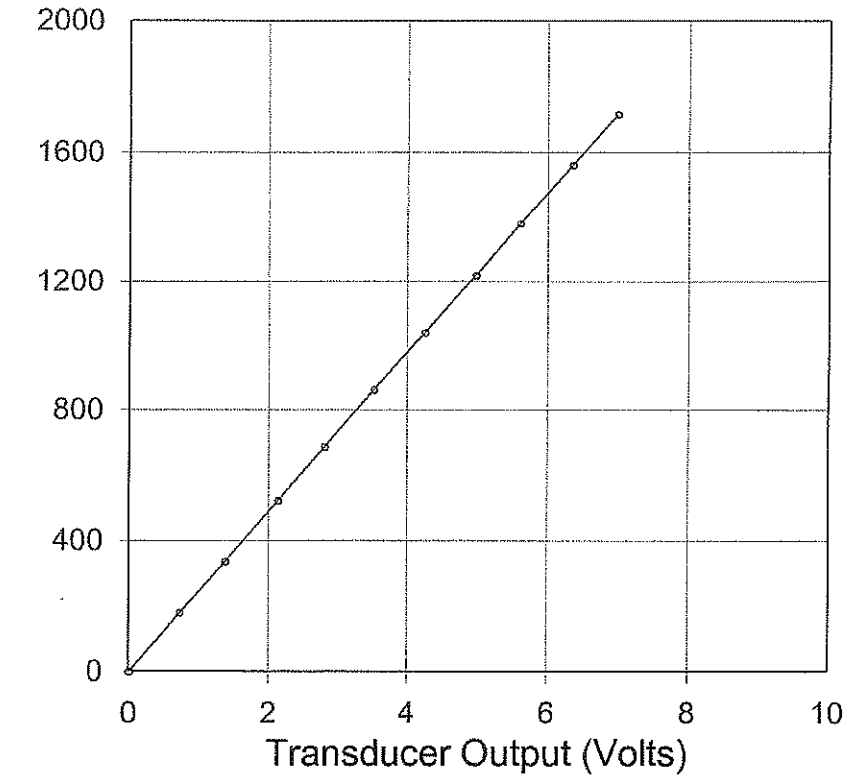

PDA Cal Factor (5.0 V) 122.9με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
180	0.72
338	1.37
520	2.13
684	2.80
862	3.51
1040	4.24
1220	4.97
1382	5.61
1562	6.35
1717	6.99

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 426.7με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: George Pennock

Calibrated on: 15-Mar-2010

Strain Transducer Calibrator System 2009 Version 1.3