Pile Dynamics, Inc.

Transducer 897W

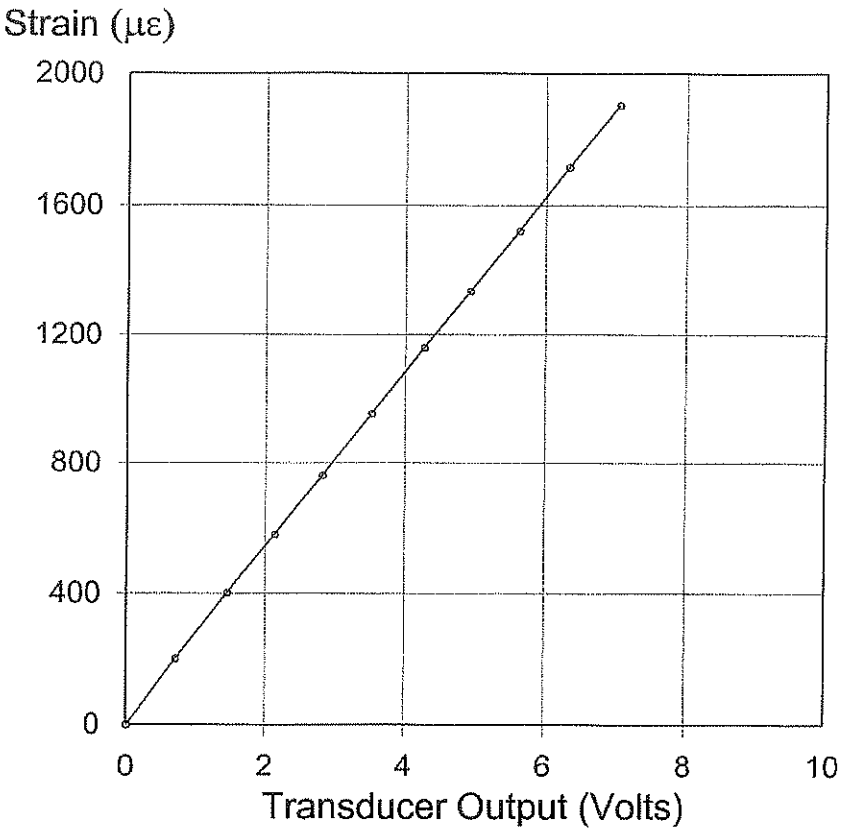

PDA Cal Factor (5.0 V) 135.3με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
203	0.71
401	1.45
579	2.13
762	2.81
953	3.51
1161	4.27
1337	4.93
1524	5.62
1717	6.32
1907	7.03

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 469.7με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: George Piscsalko

Calibrated on: 15-Mar-2010

Strain Transducer Calibrator System 2009 Version 1.3