Pile Dynamics, Inc.

Transducer 898W

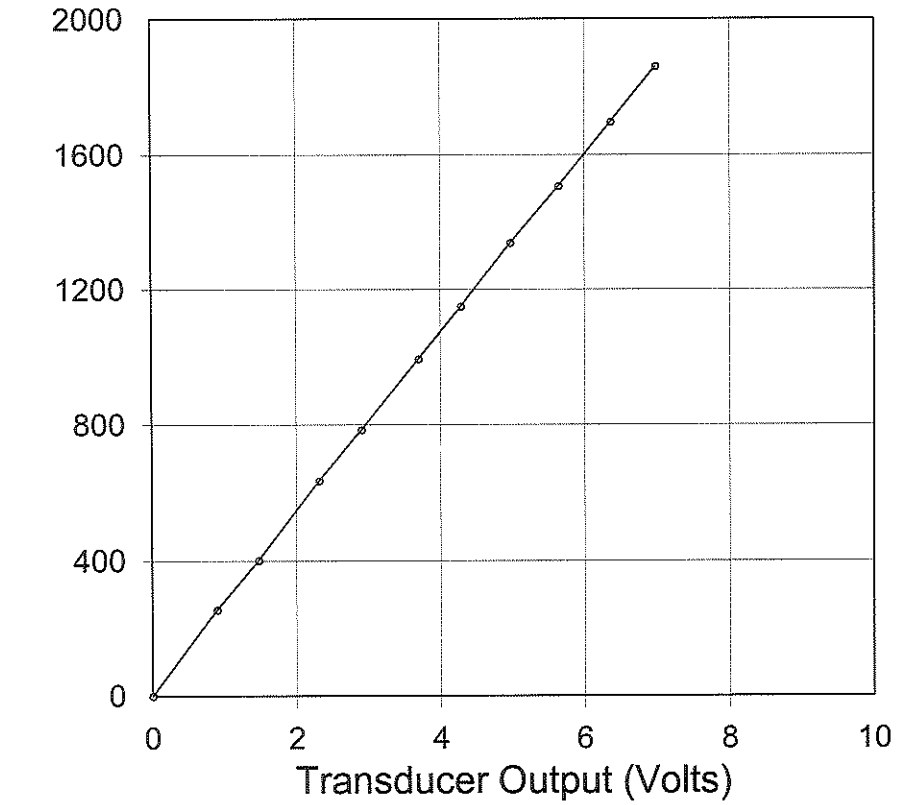

PDA Cal Factor (5.0 V) 132.7με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
256	0.89
401	1.47
635	2.31
785	2.90
994	3.69
1151	4.28
1340	4.98
1508	5.64
1699	6.36
1862	6.98

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 460.9με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 16-Apr-2009

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2