Pile Dynamics, Inc.

Transducer 899W

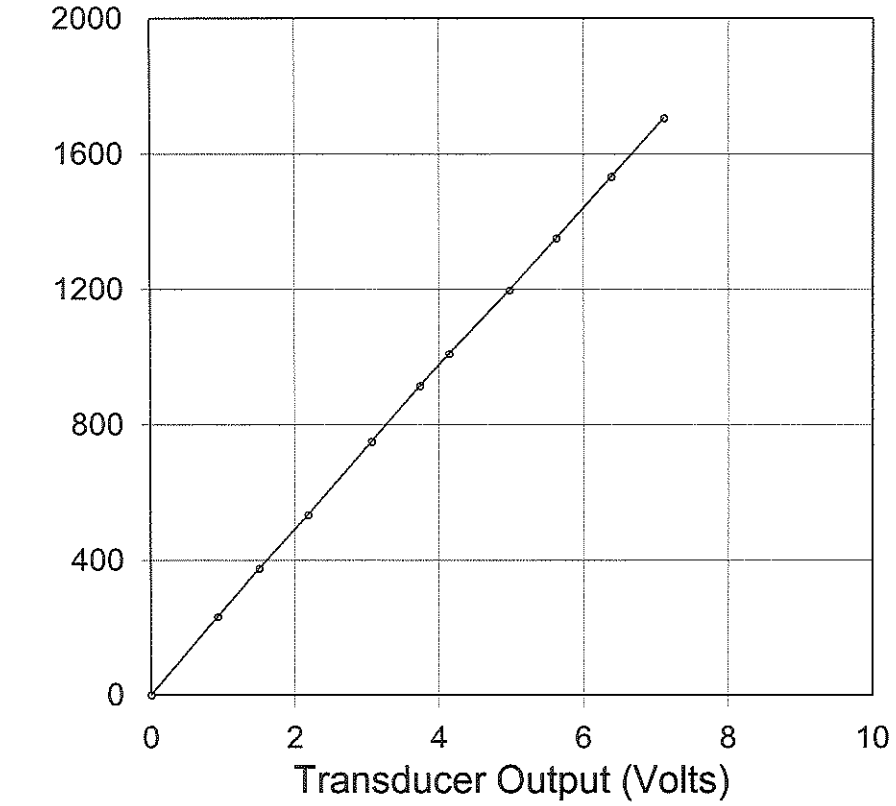

PDA Cal Factor (5.0 V) 119.4με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
233	0.93
375	1.50
534	2.18
750	3.06
914	3.73
1011	4.13
1197	4.97
1351	5.62
1533	6.38
1706	7.12

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 414.7με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 16-Apr-2009

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2