
Pile Dynamics, Inc.
Transducer 454

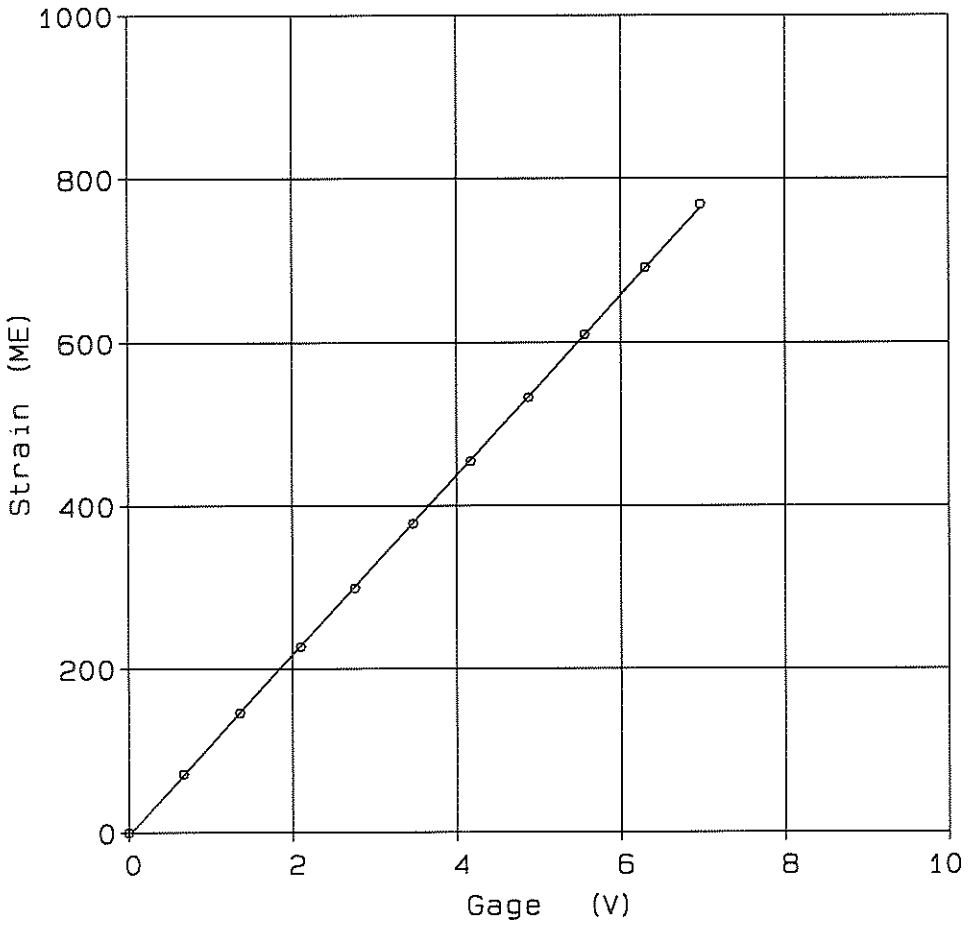

PDA Cal Factor = 110.3 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 383.0 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
72	.67
147	1.37
227	2.10
299	2.76
378	3.48
456	4.18
533	4.88
610	5.57
693	6.30
769	6.97

Calibrated by: Jason Berk

Calibrated on: 28-Feb-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2