
# Pile Dynamics Inc

# Transducer 455

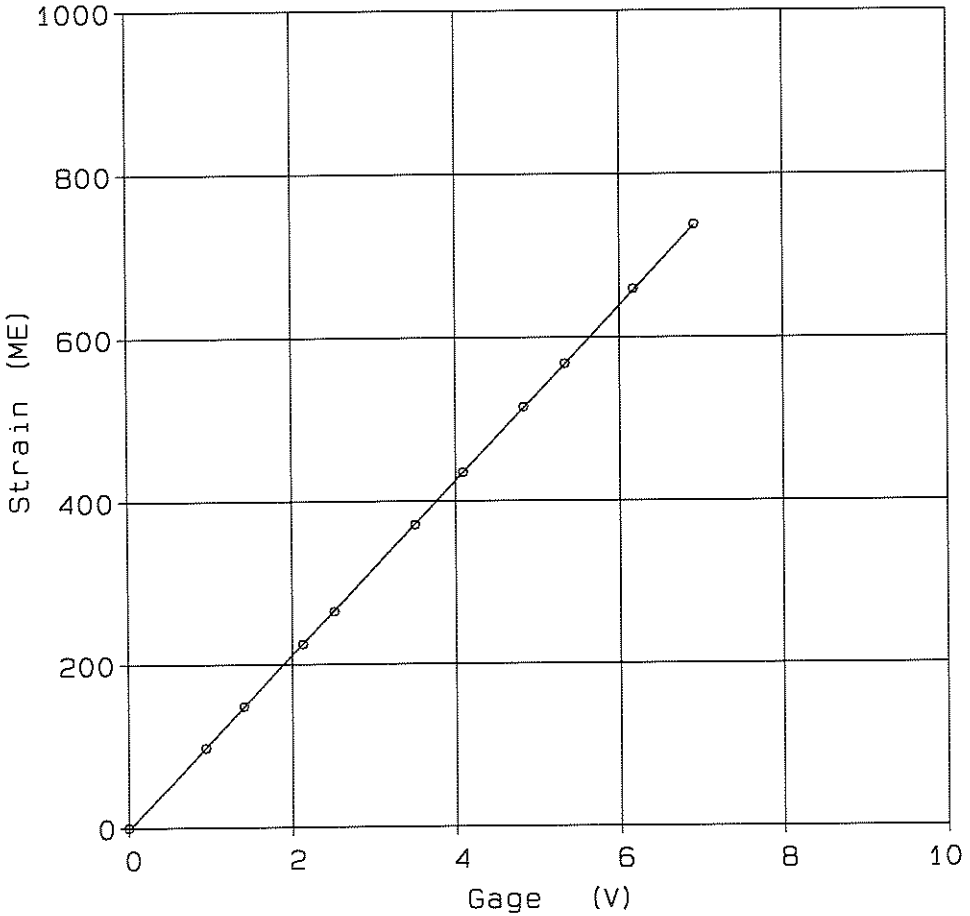


PDA Cal Factor = 106.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 371.1 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

| Strain ME | Gage V |
|---|---|
| 0 | .00 |
| 98 | .94 |
| 149 | 1.42 |
| 225 | 2.14 |
| 265 | 2.51 |
| 371 | 3.50 |
| 435 | 4.10 |
| 515 | 4.84 |
| 568 | 5.34 |
| 659 | 6.18 |
| 738 | 6.92 |

Calibrated by: J. S. Tinkey

Calibrated on: 26-May-98

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2