
Pile Dynamics Inc
Transducer 456

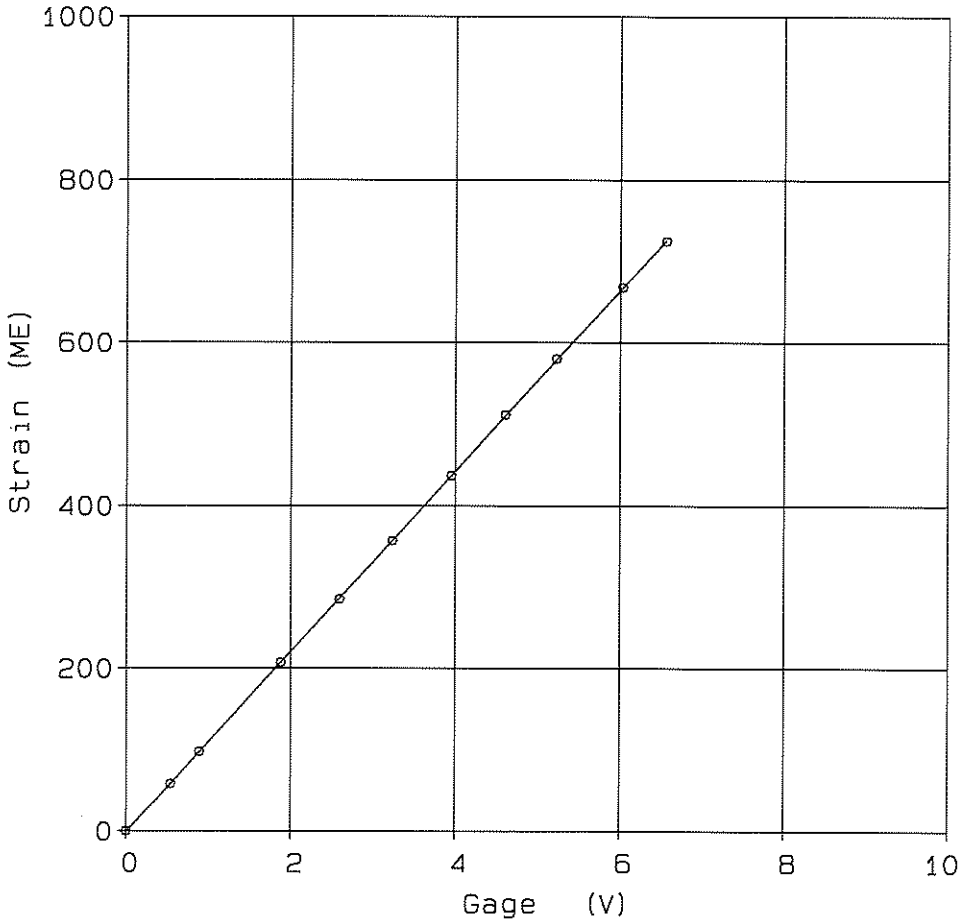

PDA Cal Factor = 110.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 384.9 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
59	.55
98	.90
208	1.89
286	2.60
357	3.24
438	3.96
511	4.62
580	5.23
668	6.03
725	6.56

Calibrated by: J. Rawlinson

Calibrated on: 26-May-98

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2