Pile Dynamics Inc
Transducer 459

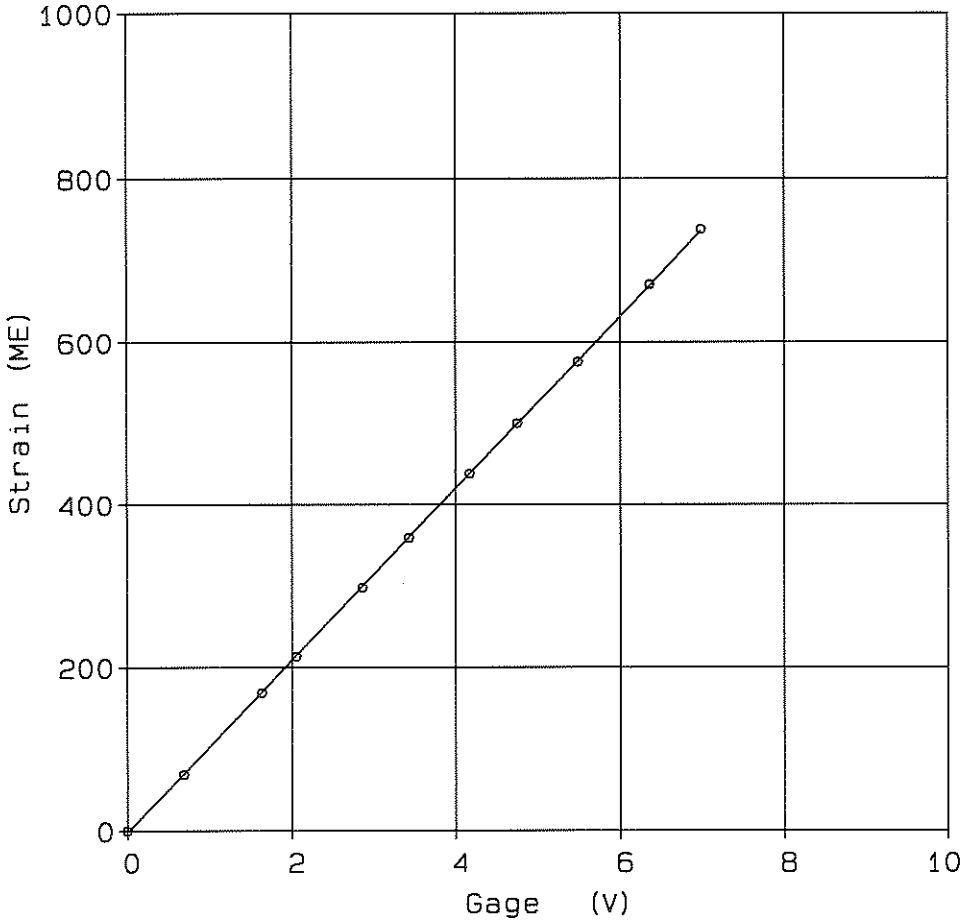

PDA Cal Factor = 105.7 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 367.2 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
70	.68
169	1.63
214	2.06
299	2.86
359	3.43
438	4.18
500	4.76
577	5.48
671	6.37
738	6.99

Calibrated by: J Dentelmann

Calibrated on: 07-Mar-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2