
Pile Dynamics, Inc.
Transducer 460

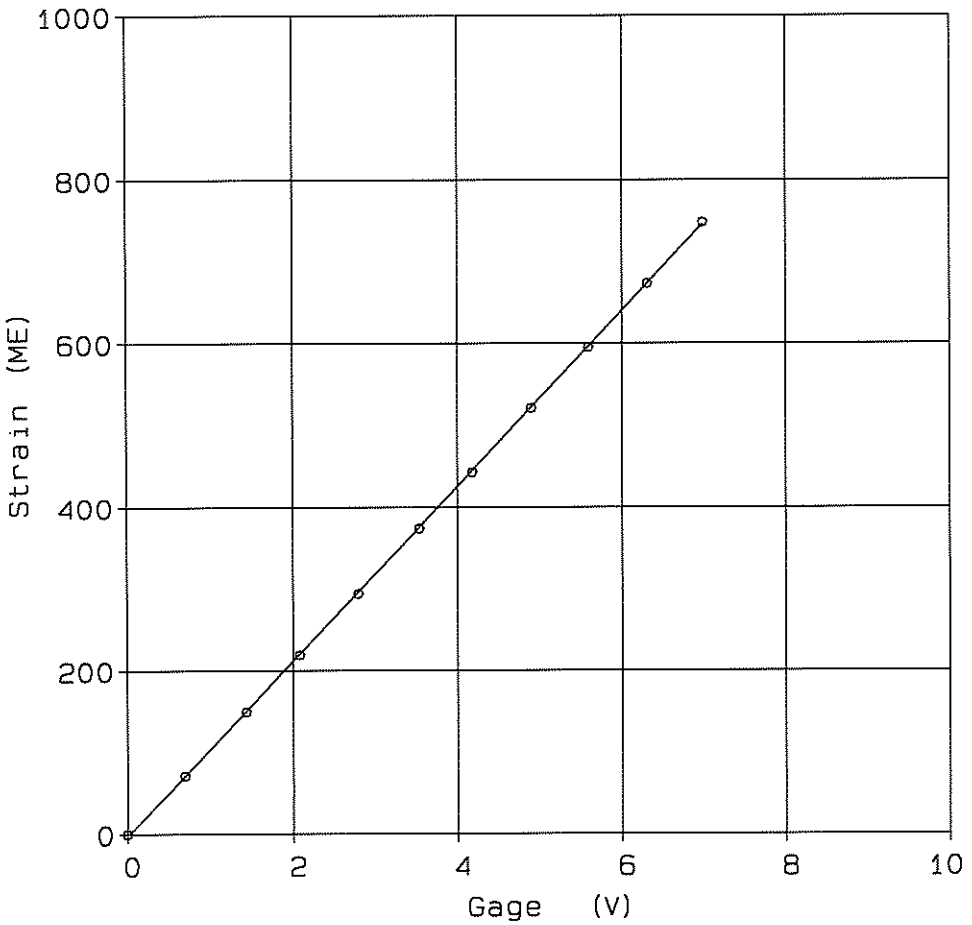

PDA Cal Factor = 107.0 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 371.6 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
73	.70
151	1.44
219	2.09
295	2.79
374	3.53
443	4.18
522	4.91
596	5.59
674	6.31
749	7.00

Calibrated by: Jason Bork

Calibrated on: 28-Feb-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2