
Pile Dynamics, Inc.
Transducer 462

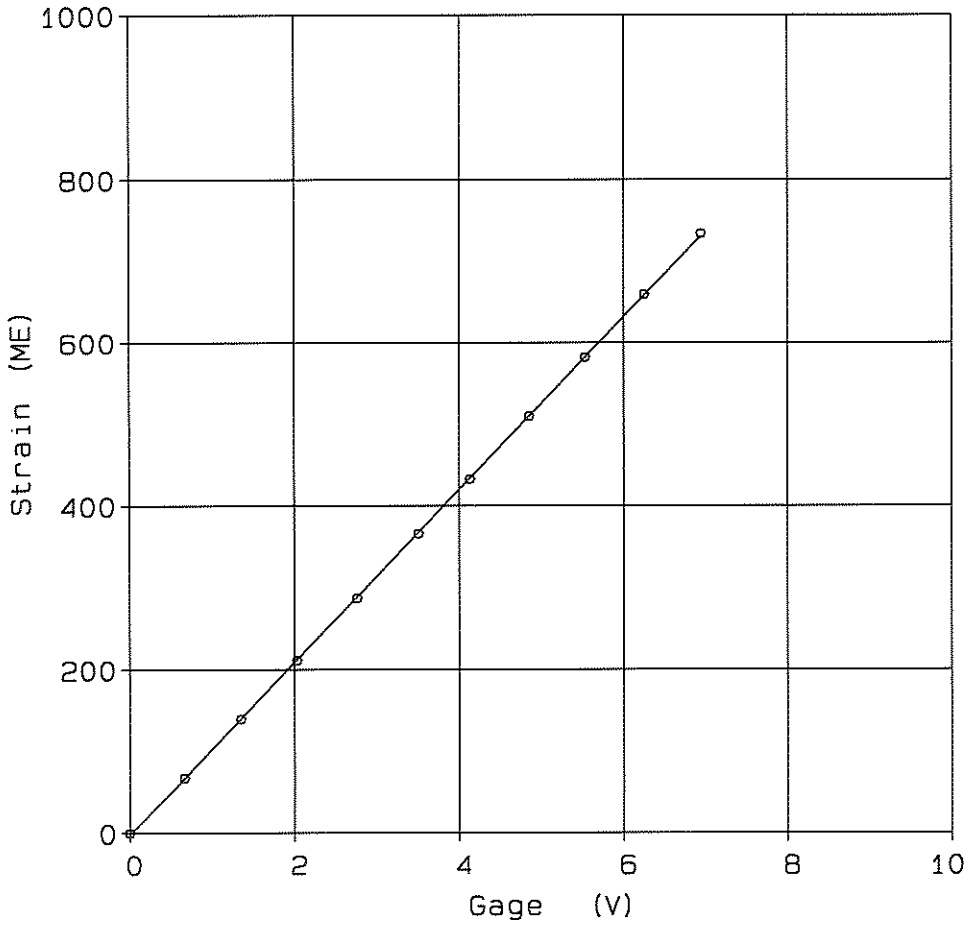

PDA Cal Factor	=	105.7 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	367.0 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
68	.66
141	1.35
212	2.04
288	2.76
367	3.50
433	4.13
510	4.85
583	5.54
659	6.25
734	6.95

Calibrated by: Jason Bork

Calibrated on: 28-Feb-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2