
Pile Dynamics, Inc.
Transducer 463

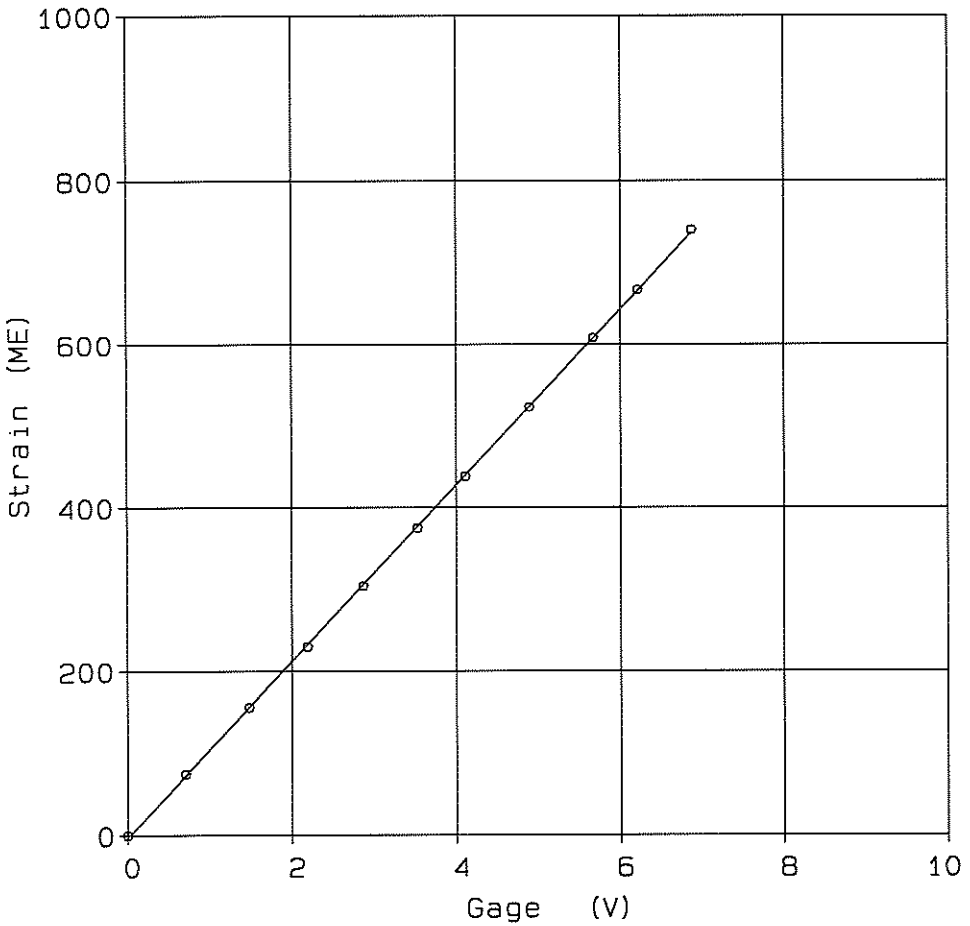

PDA Cal Factor = 107.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 374.3 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
76	.72
157	1.49
231	2.19
305	2.88
375	3.54
438	4.12
524	4.90
609	5.67
668	6.21
741	6.88

Calibrated by: Jim Stantedt

Calibrated on: 11-Jan-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2