
Pile Dynamics, Inc.
Transducer 464

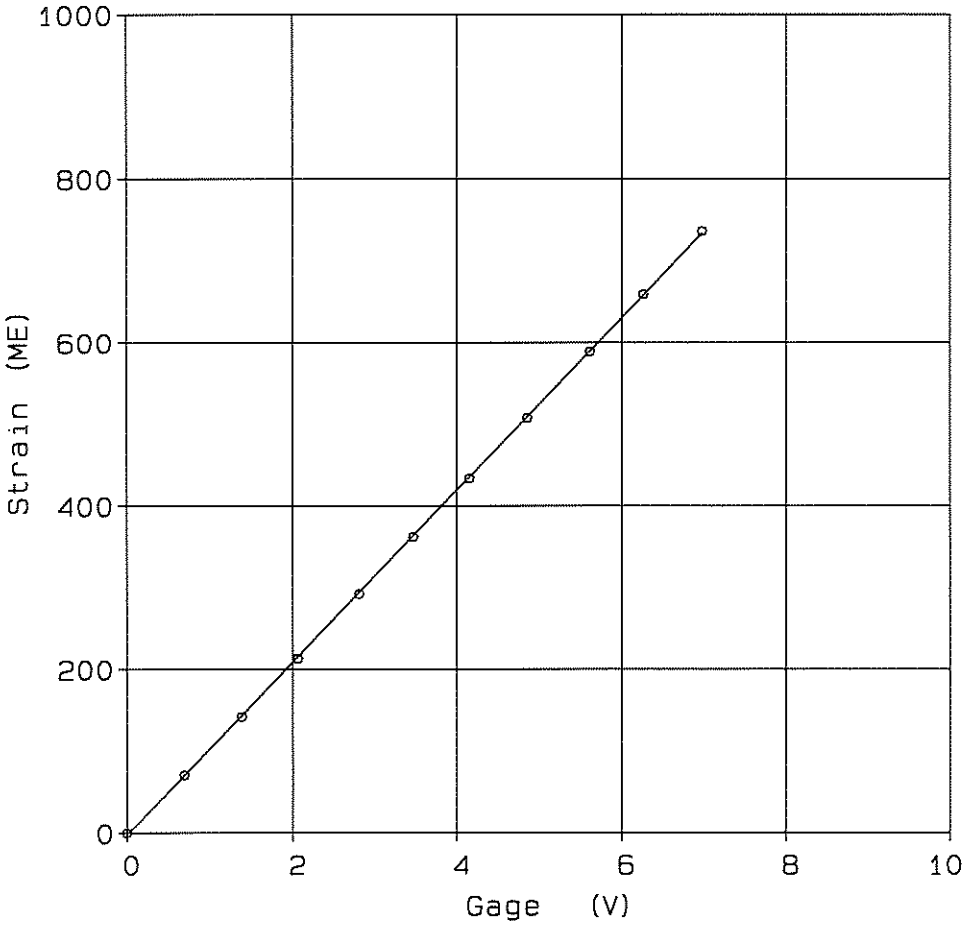

PDA Cal Factor = 105.5 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 366.3 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
72	.70
143	1.38
214	2.06
293	2.81
363	3.48
435	4.15
509	4.85
590	5.61
659	6.27
737	6.99

Calibrated by: _____

Calibrated on: 28-Feb-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2