Pile Dynamics, Inc.

Transducer 477

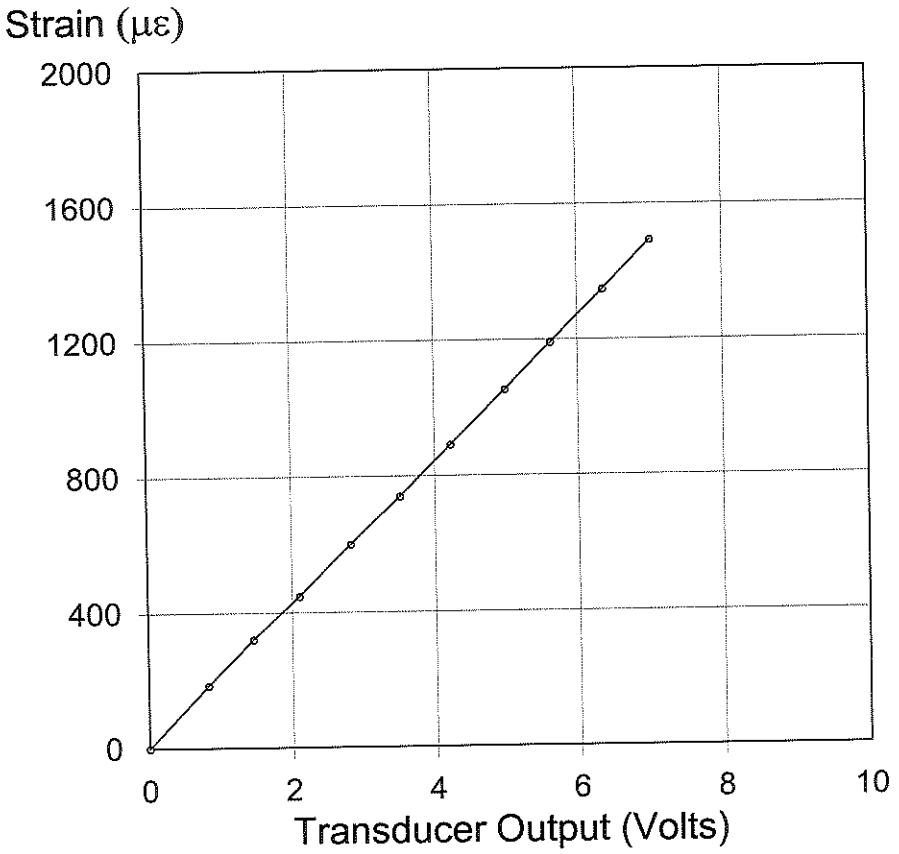

PDA Cal Factor (5.0 V) 105.6με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
186	0.82
321	1.45
448	2.10
598	2.82
739	3.51
891	4.22
1052	4.98
1191	5.62
1348	6.35
1494	7.01

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 366.7με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 10-Mar-2010

Strain Transducer Calibrator System 2009 Version 1.3