Pile Dynamics, Inc.

Transducer 478

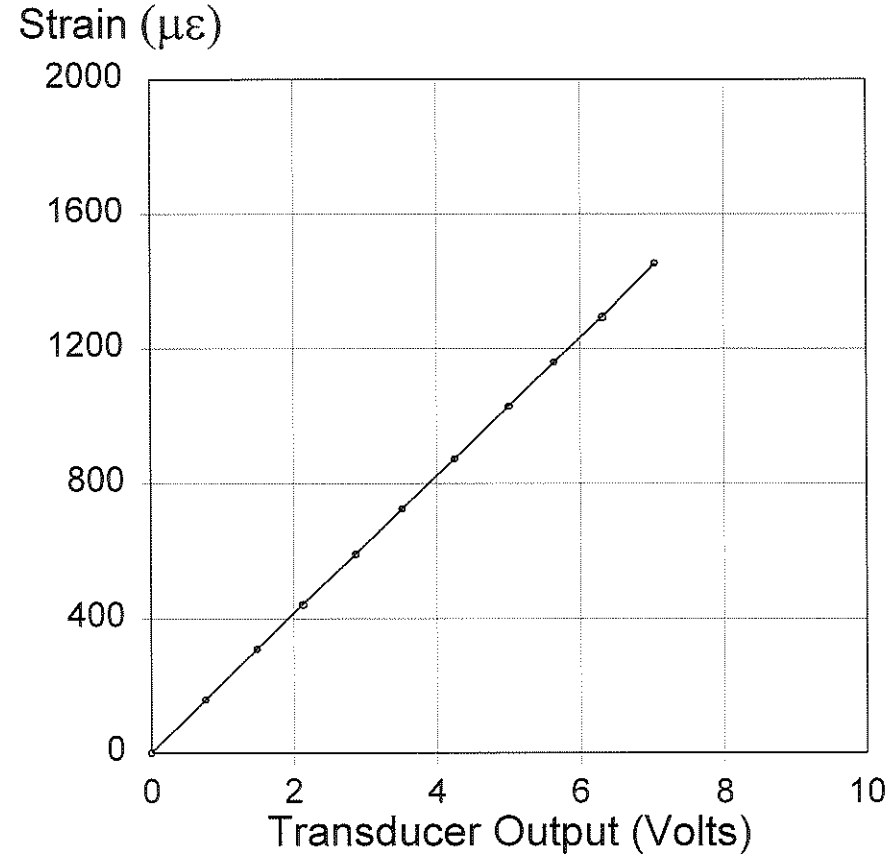

PDA Cal Factor (5.0 V) 102.7με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
160	0.76
309	1.48
440	2.12
589	2.86
723	3.51
871	4.24
1027	4.99
1159	5.63
1293	6.30
1453	7.04

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 356.7με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 26-Nov-2006

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2