Pile Dynamics, Inc.
Transducer 482

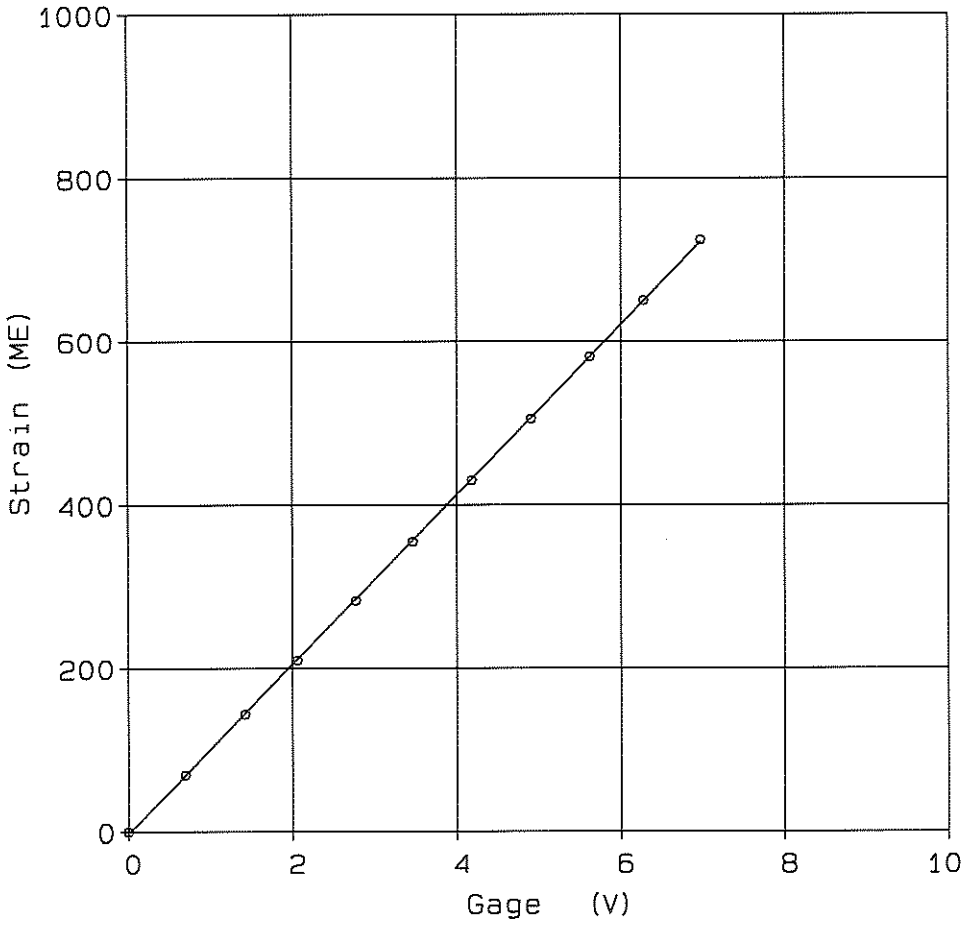

PDA Cal Factor = 103.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 360.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
70	.69
144	1.42
211	2.07
284	2.77
355	3.46
430	4.18
506	4.90
582	5.62
651	6.28
725	6.98

Calibrated by: Jason Dark

Calibrated on: 09-Mar-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2