Pile Dynamics, Inc.
Transducer 483

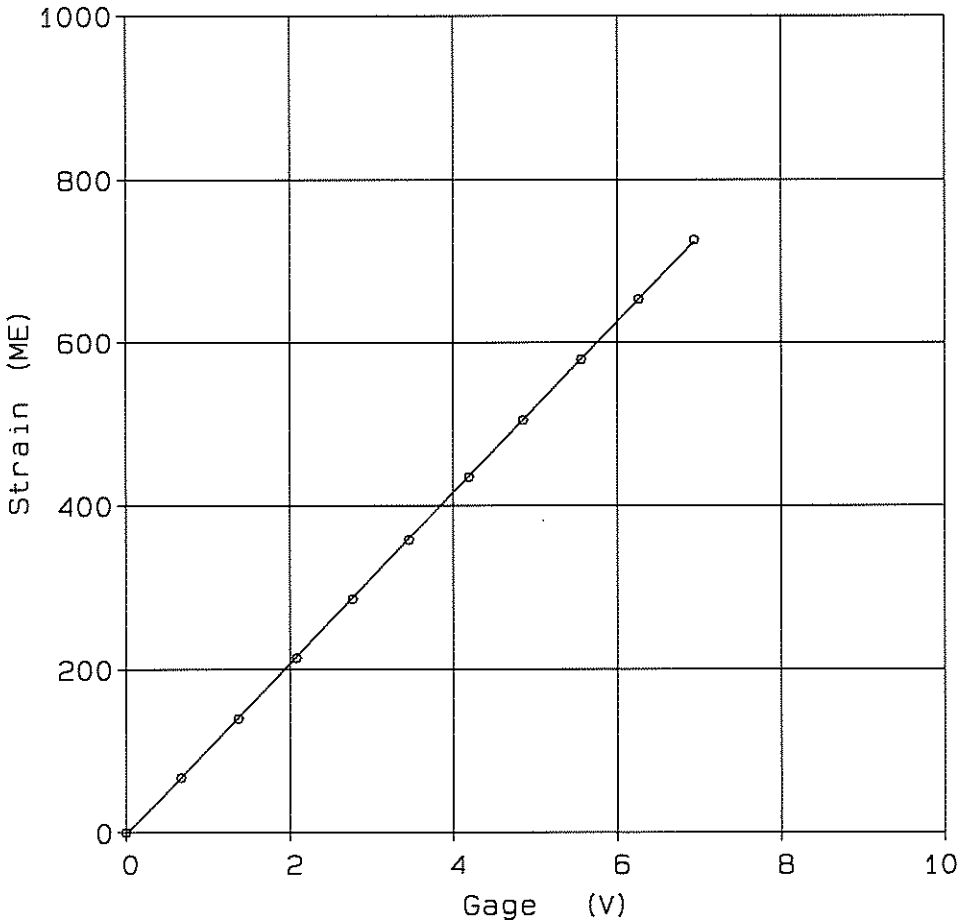

PDA Cal Factor = 104.6 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 363.2 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
69	.67
141	1.37
214	2.08
287	2.77
358	3.46
435	4.19
506	4.86
580	5.57
654	6.27
727	6.95

Calibrated by: Jason Bank

Calibrated on: 09-Mar-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2