Pile Dynamics, Inc.
Transducer 484

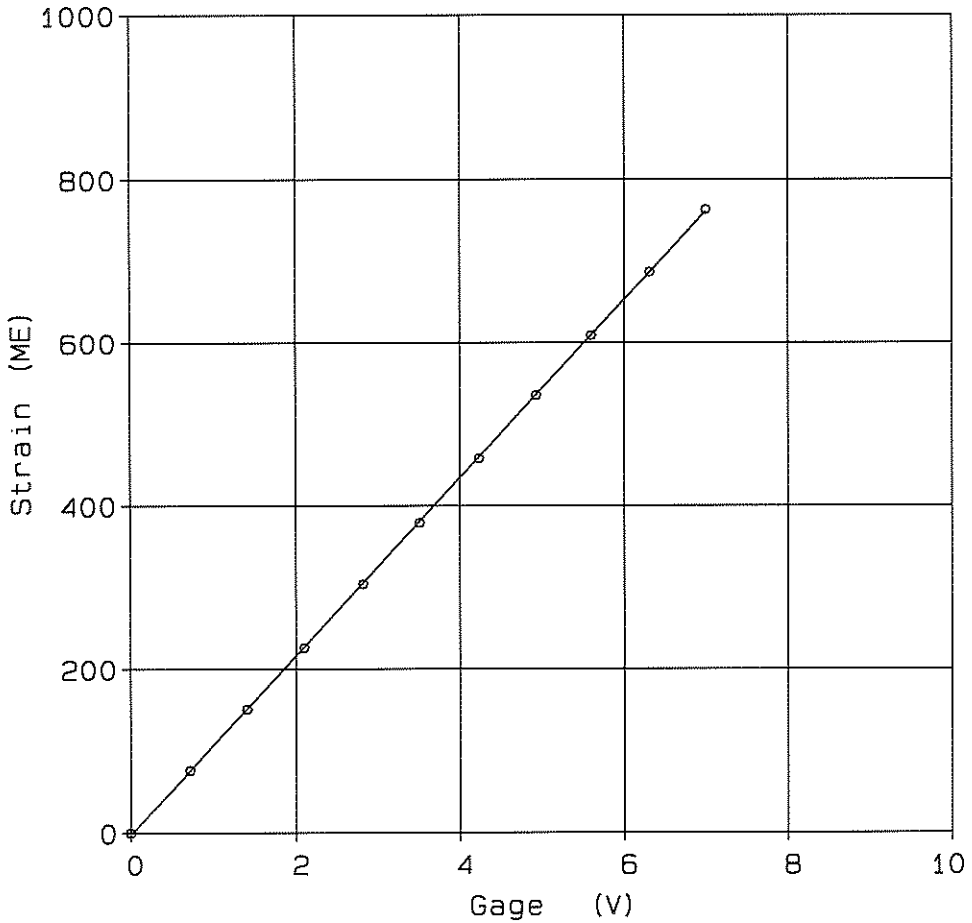

PDA Cal Factor	=	109.3 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	379.4 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
78	.73
151	1.41
226	2.10
305	2.83
379	3.51
459	4.24
536	4.93
610	5.60
688	6.31
764	6.99

Calibrated by: Jason Berk

Calibrated on: 09-Mar-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2