Pile Dynamics, Inc.
Transducer 485

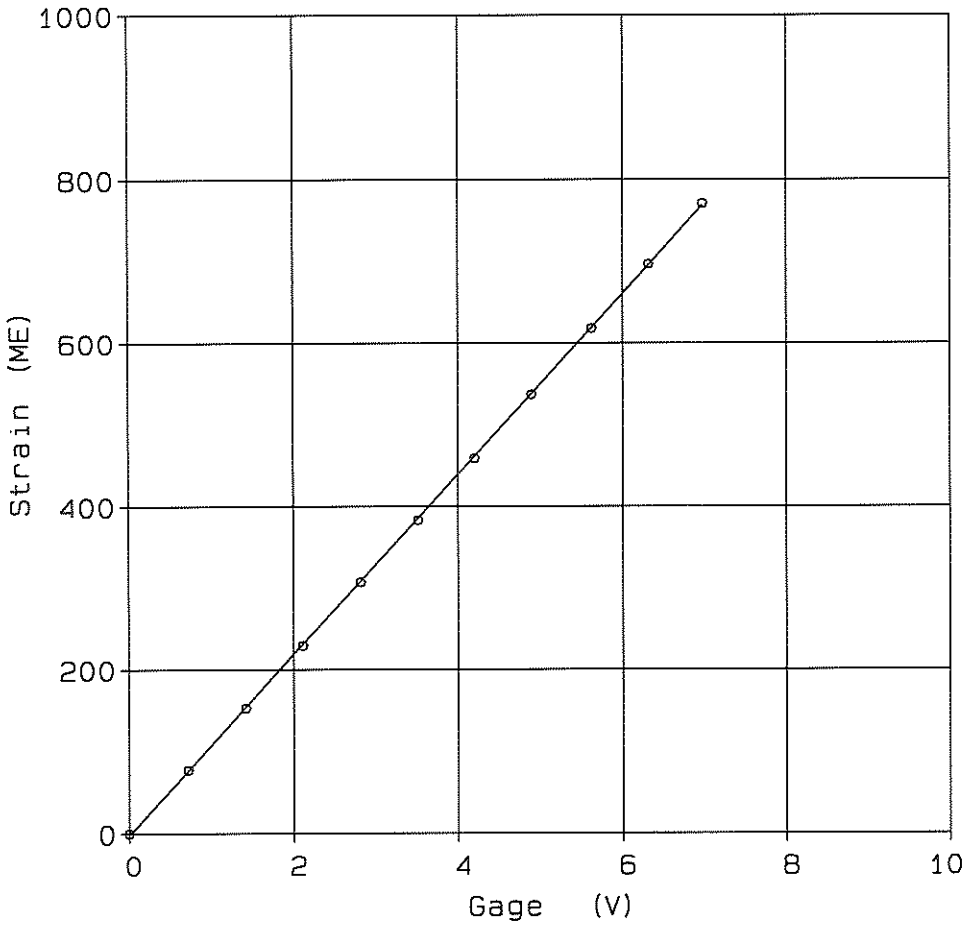

PDA Cal Factor = 110.5 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 383.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
78	.72
154	1.42
230	2.11
307	2.82
384	3.51
460	4.20
537	4.89
618	5.62
697	6.32
772	6.98

Calibrated by: Jason Gold

Calibrated on: 09-Mar-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2