Pile Dynamics, Inc.
Transducer 486

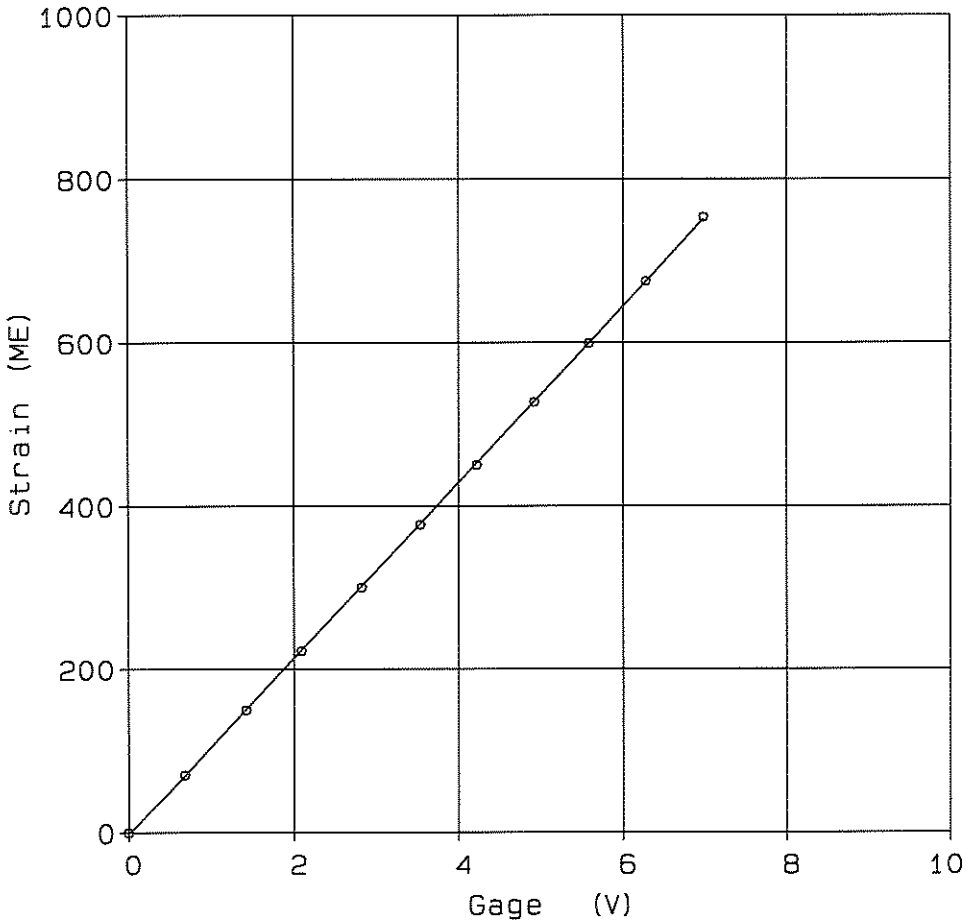

PDA Cal Factor = 107.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 374.2 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
71	.68
150	1.42
222	2.10
300	2.82
377	3.54
451	4.22
527	4.92
599	5.59
675	6.28
754	7.00

Calibrated by: Jason Bank

Calibrated on: 09-Mar-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2