Pile Dynamics, Inc.
Transducer 488

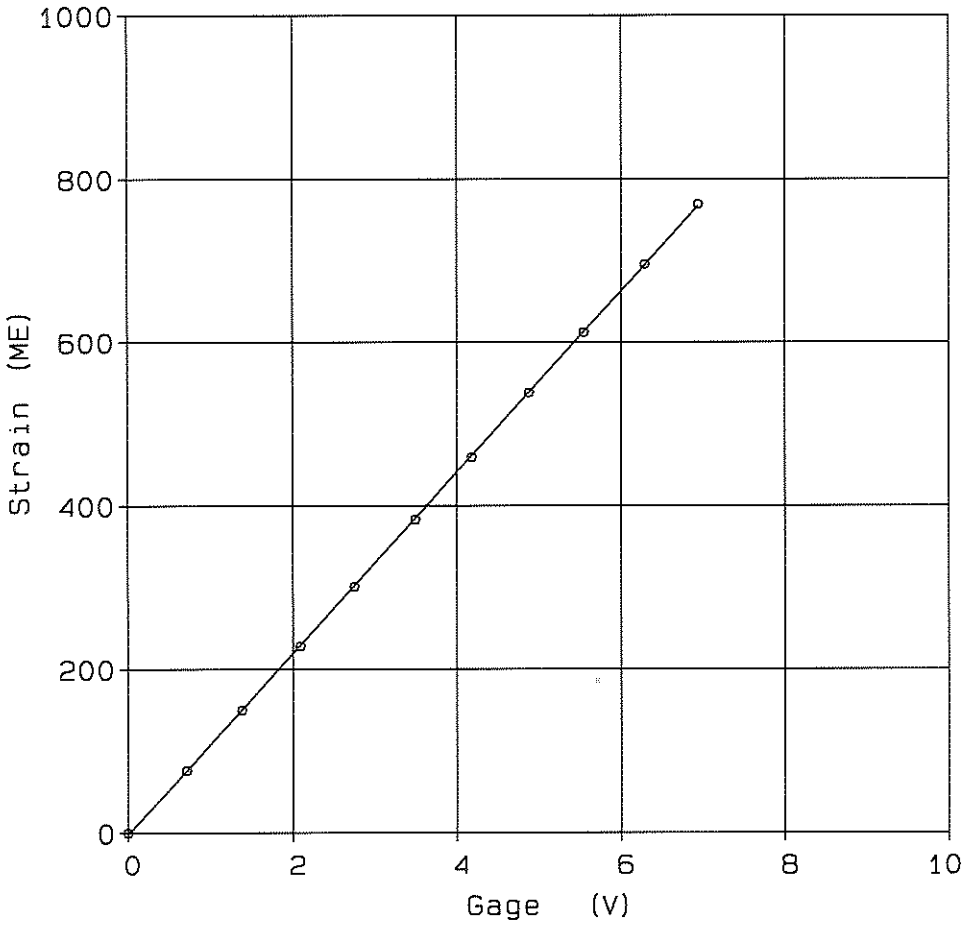

PDA Cal Factor = 110.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 384.9 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
77	.71
150	1.38
229	2.10
301	2.75
383	3.49
460	4.18
539	4.89
613	5.55
696	6.29
770	6.95

Calibrated by: Jason Bork

Calibrated on: 09-Mar-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2