Pile Dynamics, Inc.
Transducer 489

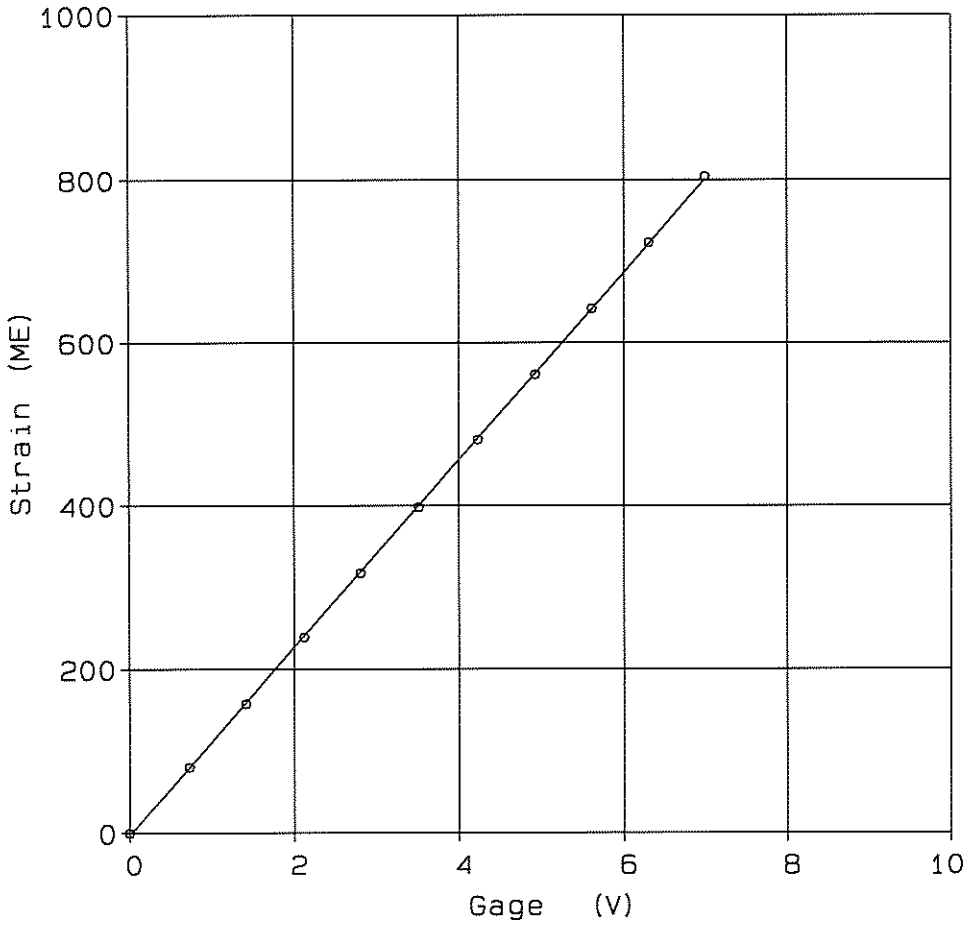

PDA Cal Factor = 114.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 399.0 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
81	.72
159	1.41
239	2.12
318	2.81
398	3.51
482	4.23
562	4.93
643	5.62
723	6.31
804	7.00

Calibrated by: Jason Bank

Calibrated on: 09-Mar-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2