Pile Dynamics, Inc.
Transducer 492

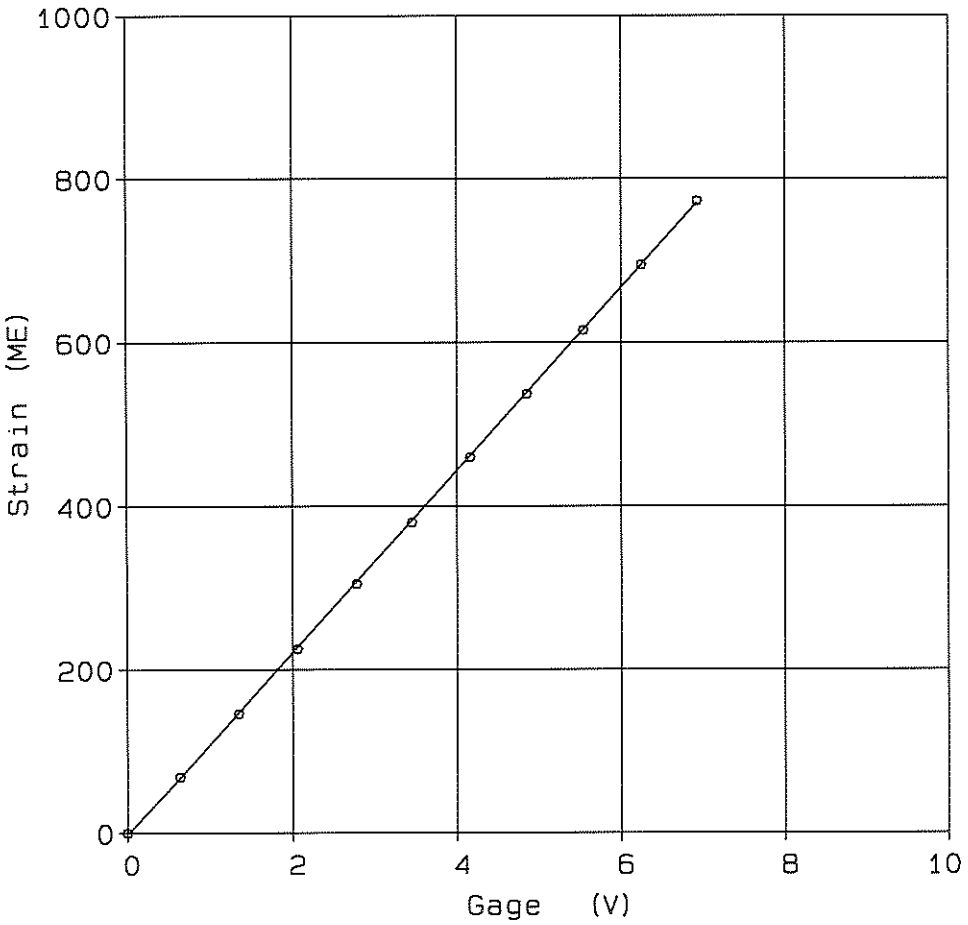

PDA Cal Factor	=	111.6 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	387.5 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
69	.64
146	1.34
226	2.06
306	2.78
381	3.46
460	4.17
538	4.85
616	5.54
696	6.25
774	6.94

Calibrated by: _____

Calibrated on: 09-Mar-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2