Pile Dynamics Inc
Transducer 494

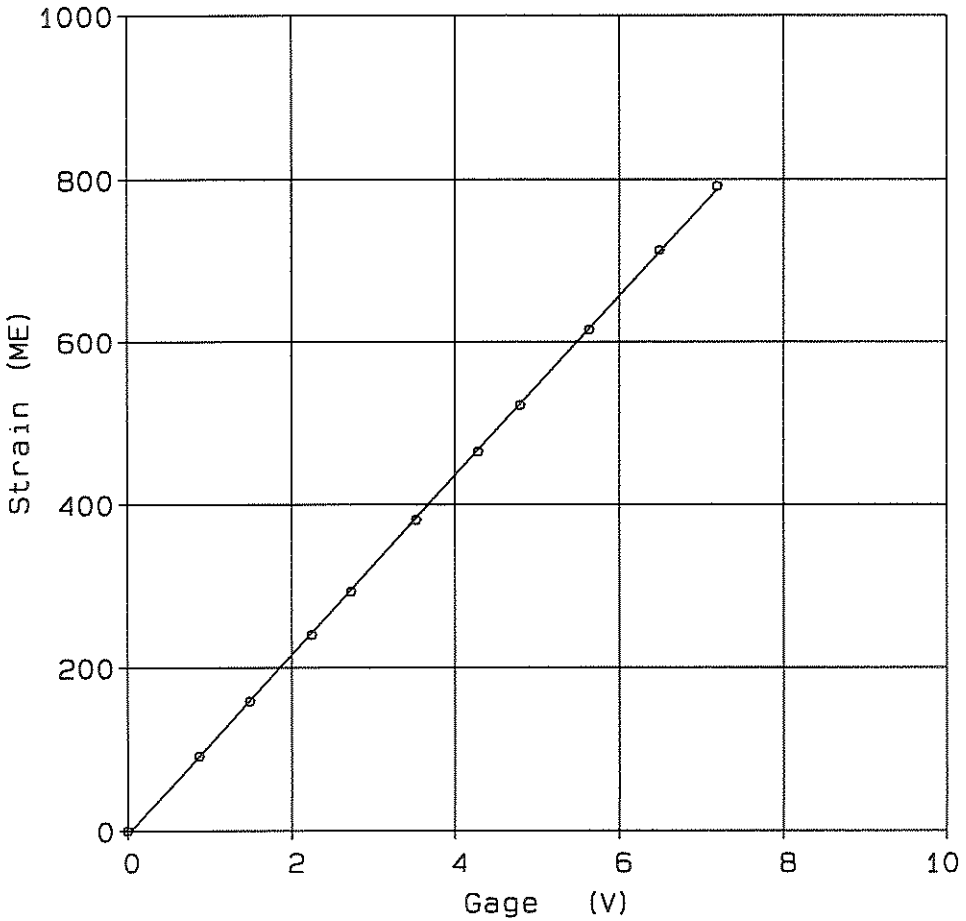

PDA Cal Factor = 110.2 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 382.7 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
93	.88
160	1.49
241	2.24
293	2.72
382	3.53
466	4.29
522	4.80
616	5.63
714	6.50
792	7.19

Calibrated by: J. Deutschendorf

Calibrated on: 21-Oct-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2