Pile Dynamics, Inc.
Transducer 496

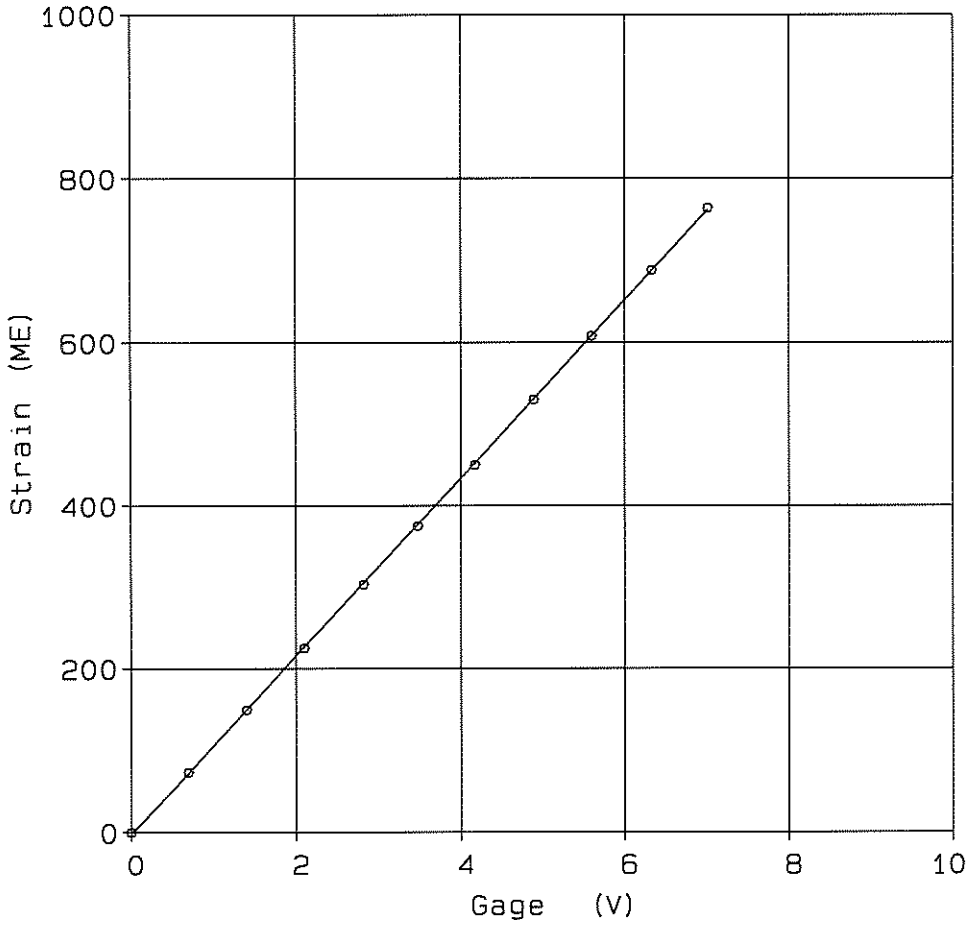

PDA Cal Factor = 108.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 378.2 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
75	.70
151	1.40
225	2.10
303	2.82
375	3.48
451	4.17
530	4.90
608	5.61
688	6.33
764	7.02

Calibrated by: _____

Calibrated on: 09-Mar-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2