Pile Dynamics, Inc.
Transducer 501

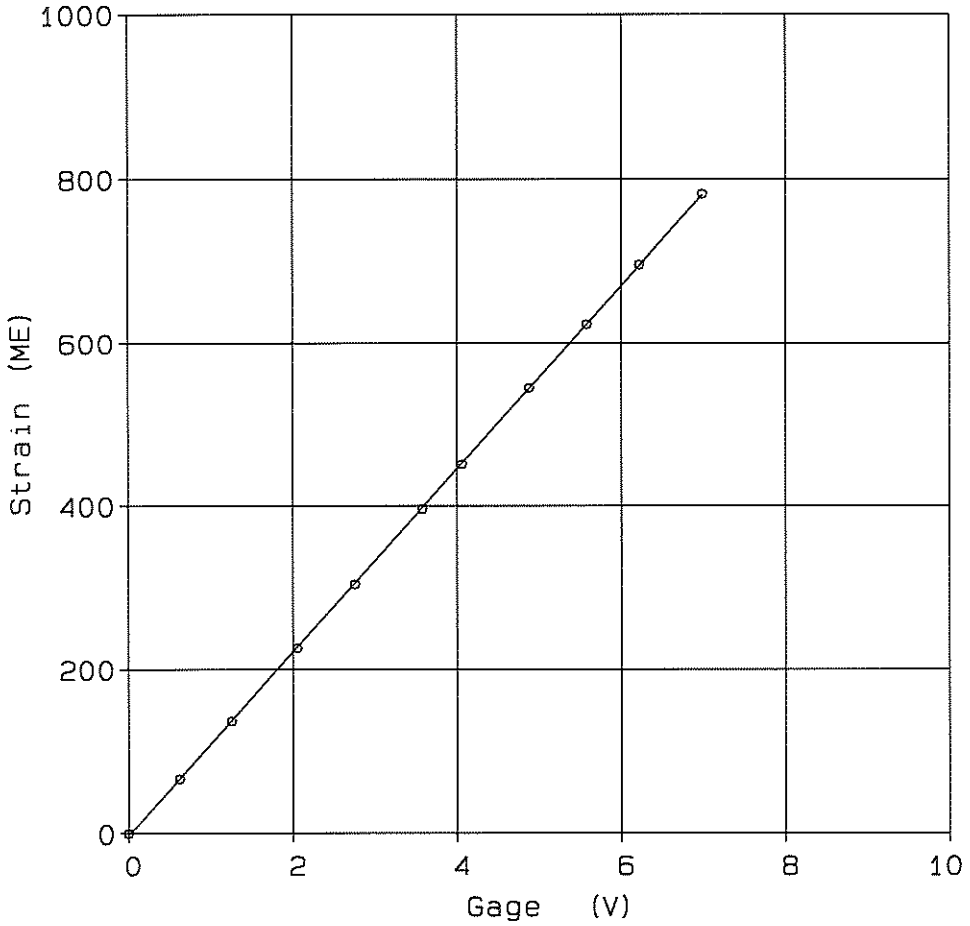

PDA Cal Factor = 112.0 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 389.0 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
68	.62
138	1.25
227	2.05
305	2.76
397	3.57
451	4.06
546	4.89
624	5.58
696	6.23
782	6.99

Calibrated by: Jim Deutschold

Calibrated on: 11-Jan-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2