Pile Dynamics, Inc.
Transducer 502

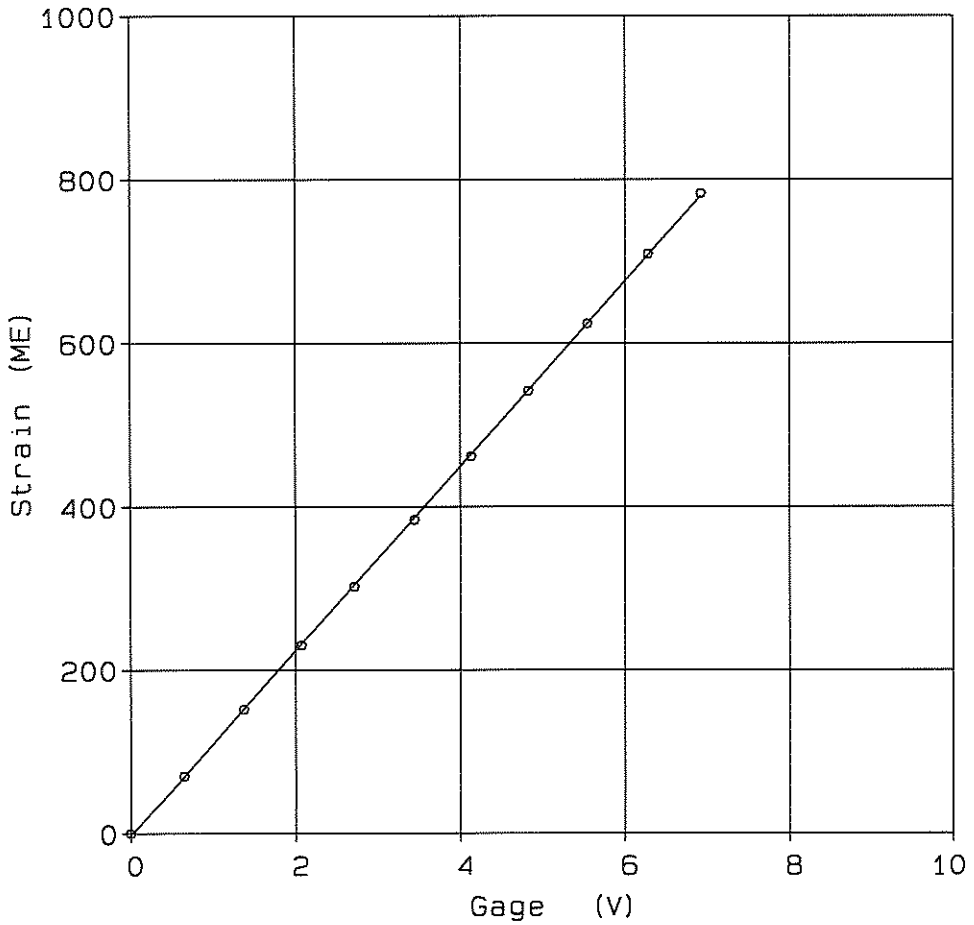

PDA Cal Factor	=	113.3 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	393.3 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
71	.65
152	1.37
231	2.07
303	2.72
384	3.44
463	4.13
542	4.83
625	5.55
709	6.28
784	6.92

Calibrated by: Jason Berk

Calibrated on: 14-Mar-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2