Pile Dynamics, Inc.
Transducer 503

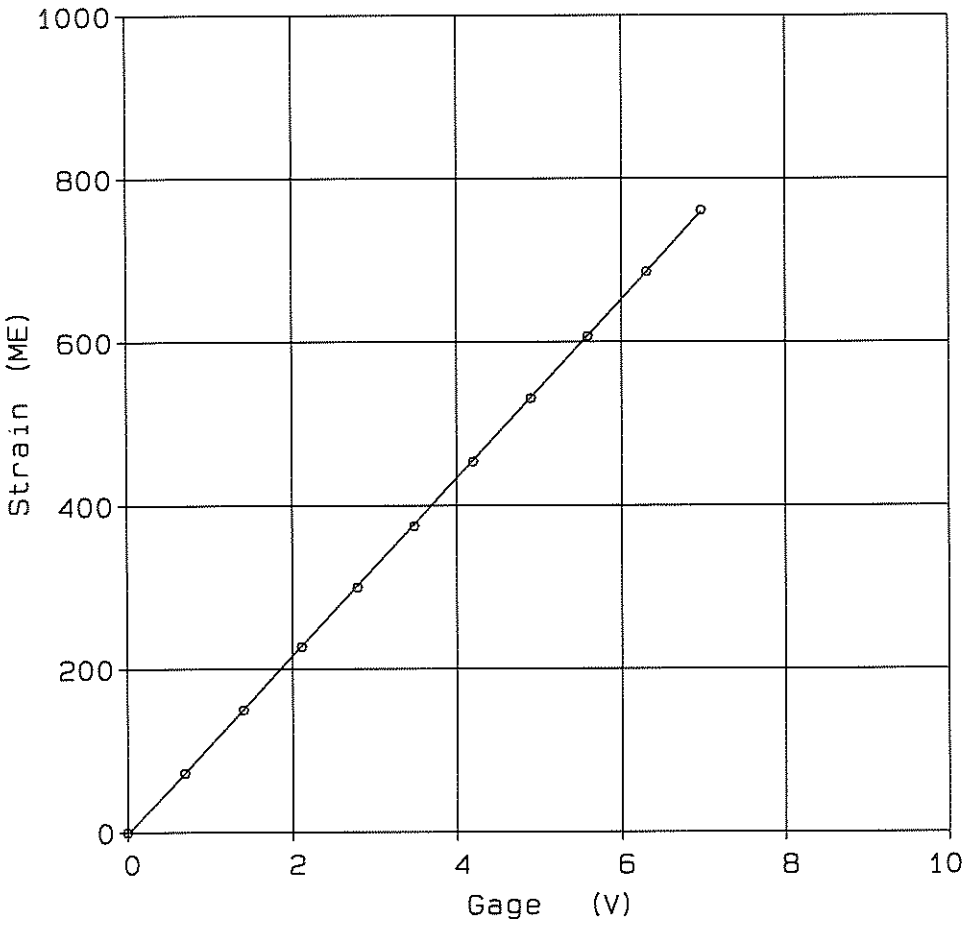

PDA Cal Factor = 109.0 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 378.5 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
74	.69
150	1.41
227	2.12
301	2.79
376	3.48
454	4.20
532	4.91
607	5.60
687	6.32
761	6.99

Calibrated by:

Calibrated on: 14-Mar-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2