Pile Dynamics, Inc.
Transducer 505

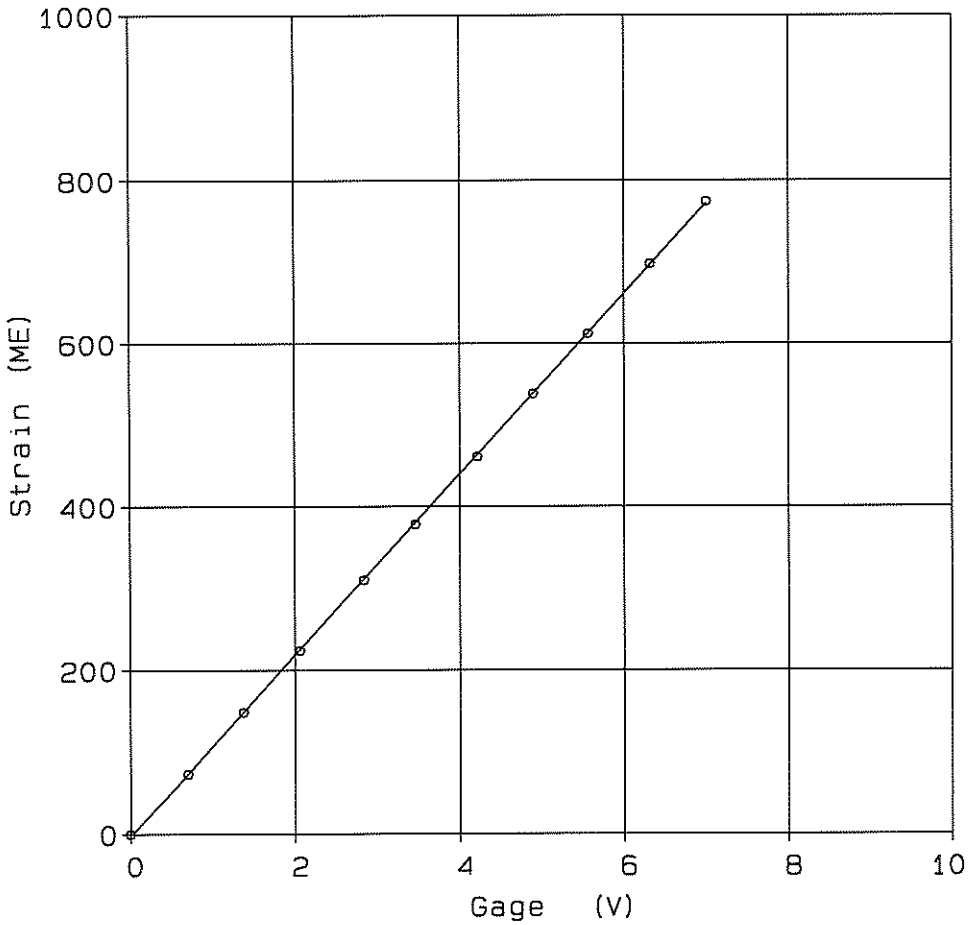

PDA Cal Factor = 110.6 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 384.2 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
75	.69
150	1.38
225	2.07
310	2.85
378	3.46
462	4.21
538	4.90
613	5.57
698	6.33
775	7.01

Calibrated by: Jason Bork

Calibrated on: 14-Mar-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2