Pile Dynamics Inc
Transducer 506

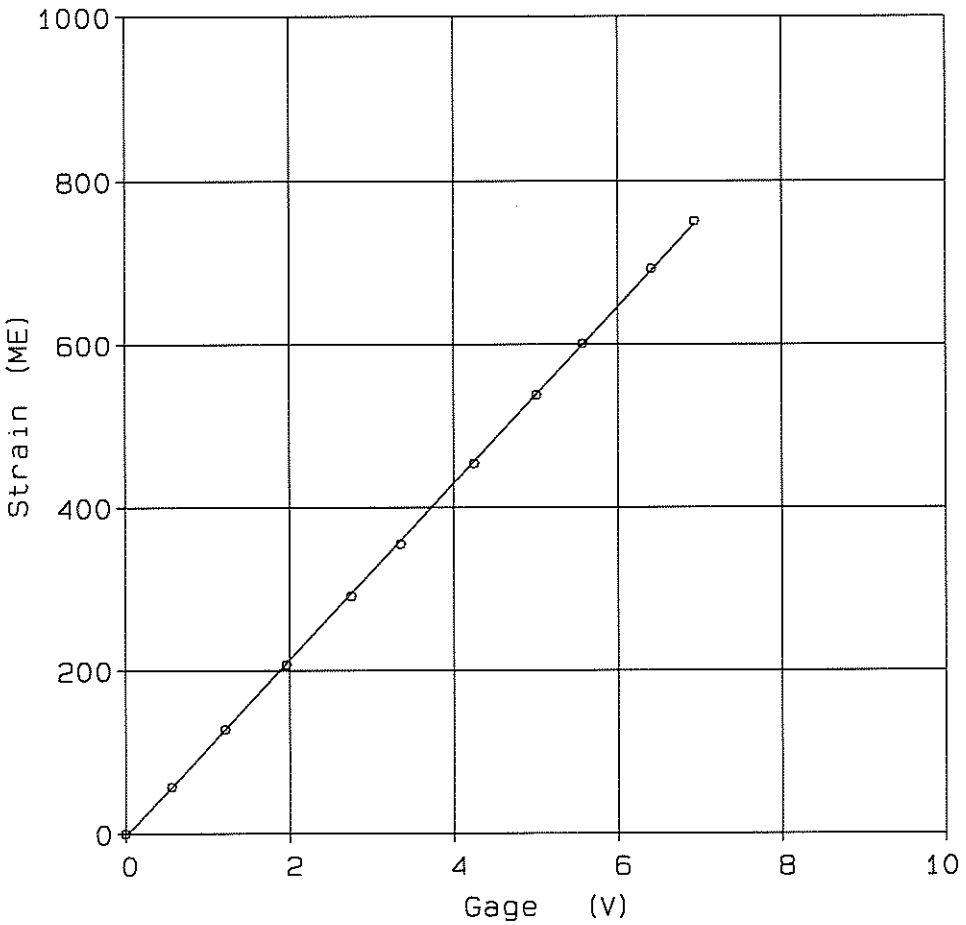

PDA Cal Factor = 108.3 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 376.1 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
59	.56
129	1.22
208	1.96
292	2.76
355	3.36
455	4.26
538	5.02
602	5.58
693	6.41
751	6.94

Calibrated by: J. Dentdy

Calibrated on: 28-Jan-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2