Pile Dynamics Inc
Transducer 507

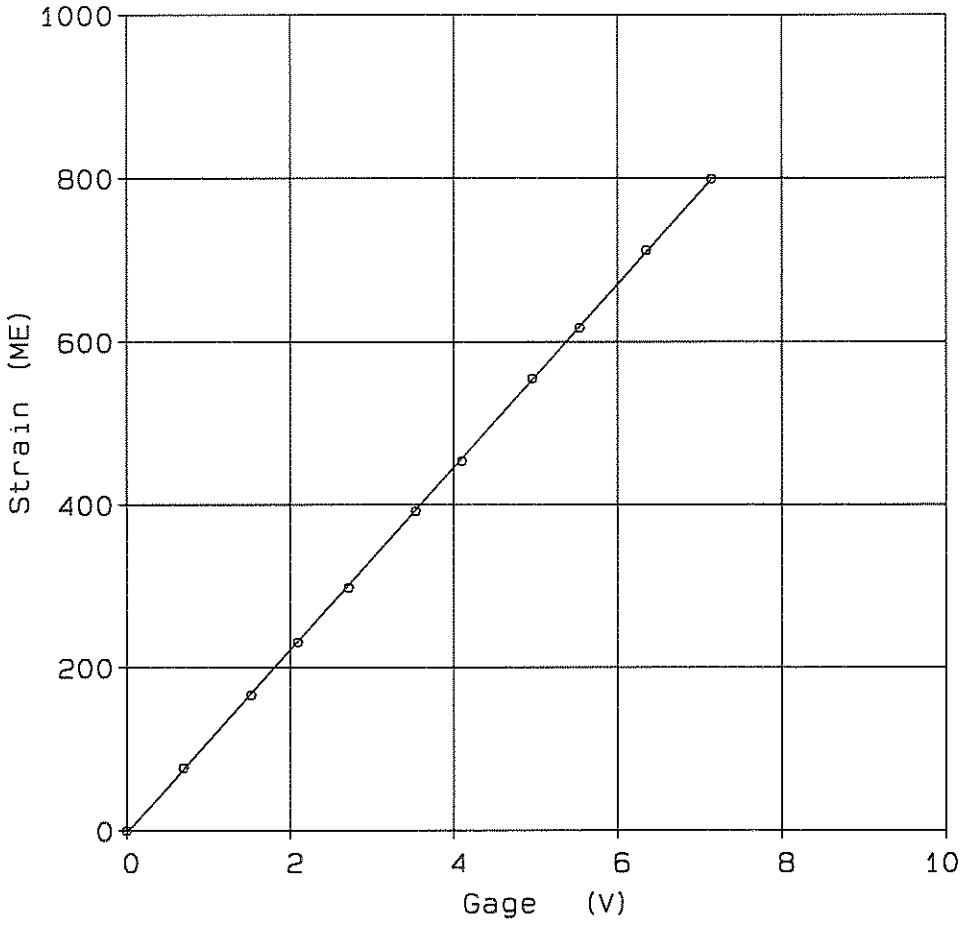

PDA Cal Factor	=	112.2 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	389.6 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
78	.70
166	1.52
232	2.10
299	2.72
392	3.53
455	4.10
556	4.97
618	5.54
713	6.35
799	7.14

Calibrated by: J. Rawlings

Calibrated on: 04-Mar-98

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2