Pile Dynamics, Inc.
Transducer 508

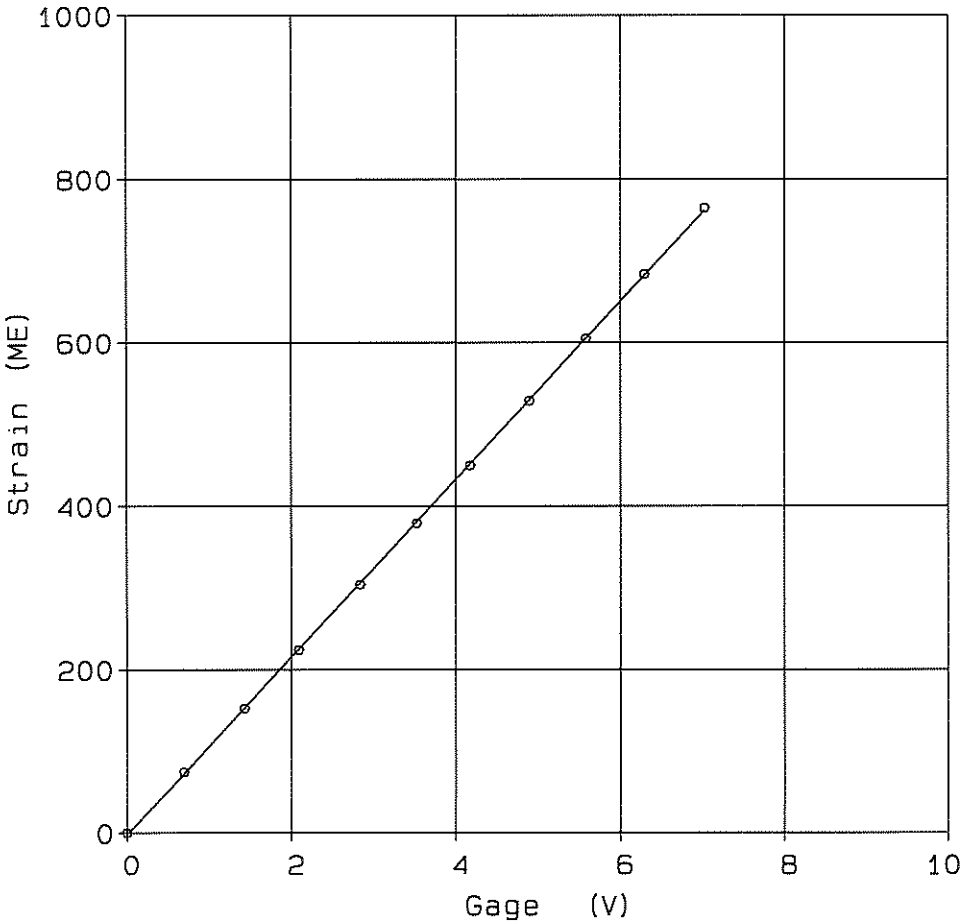

PDA Cal Factor = 108.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 377.9 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
75	.70
154	1.43
224	2.09
305	2.84
379	3.53
451	4.18
529	4.89
606	5.59
685	6.30
765	7.03

Calibrated by: Jason Bork

Calibrated on: 14-Mar-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2