Pile Dynamics, Inc.
Transducer 509

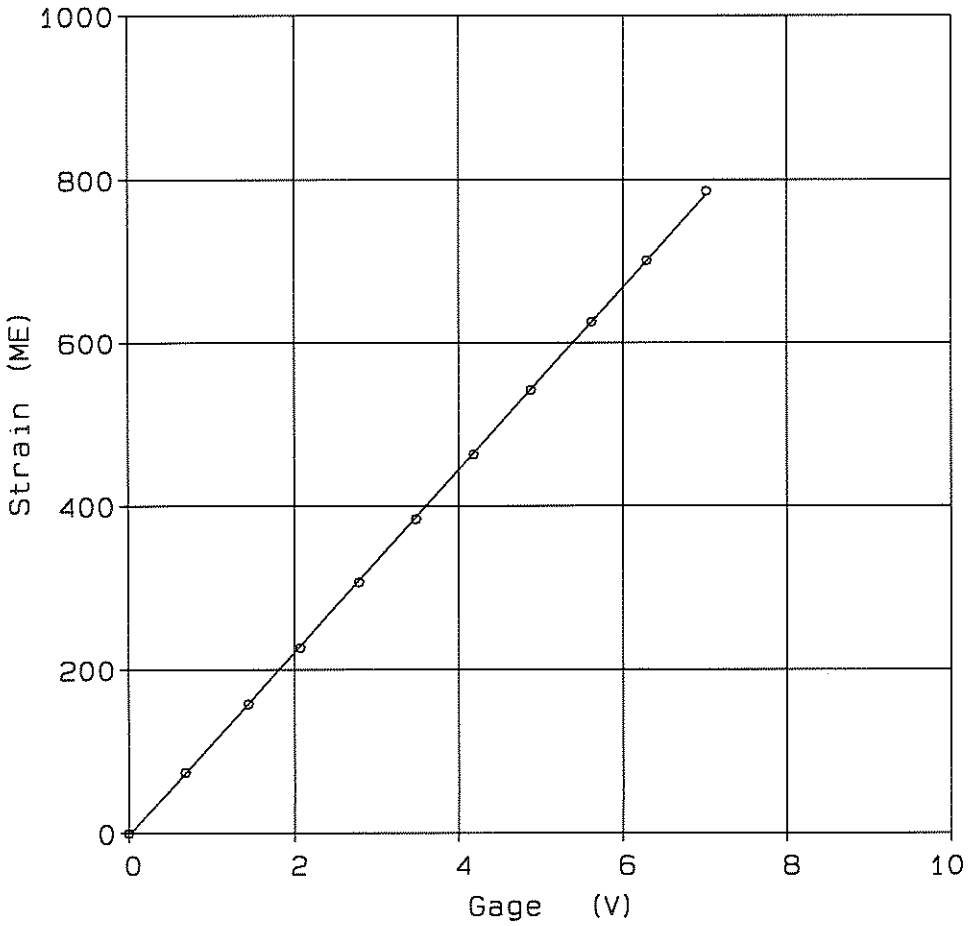

PDA Cal Factor = 111.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 388.3 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
75	.69
158	1.44
227	2.07
308	2.80
384	3.48
463	4.18
543	4.89
627	5.63
701	6.29
786	7.03

Calibrated by: Jason Bork

Calibrated on: 14-Mar-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2