Pile Dynamics Inc

Transducer 510

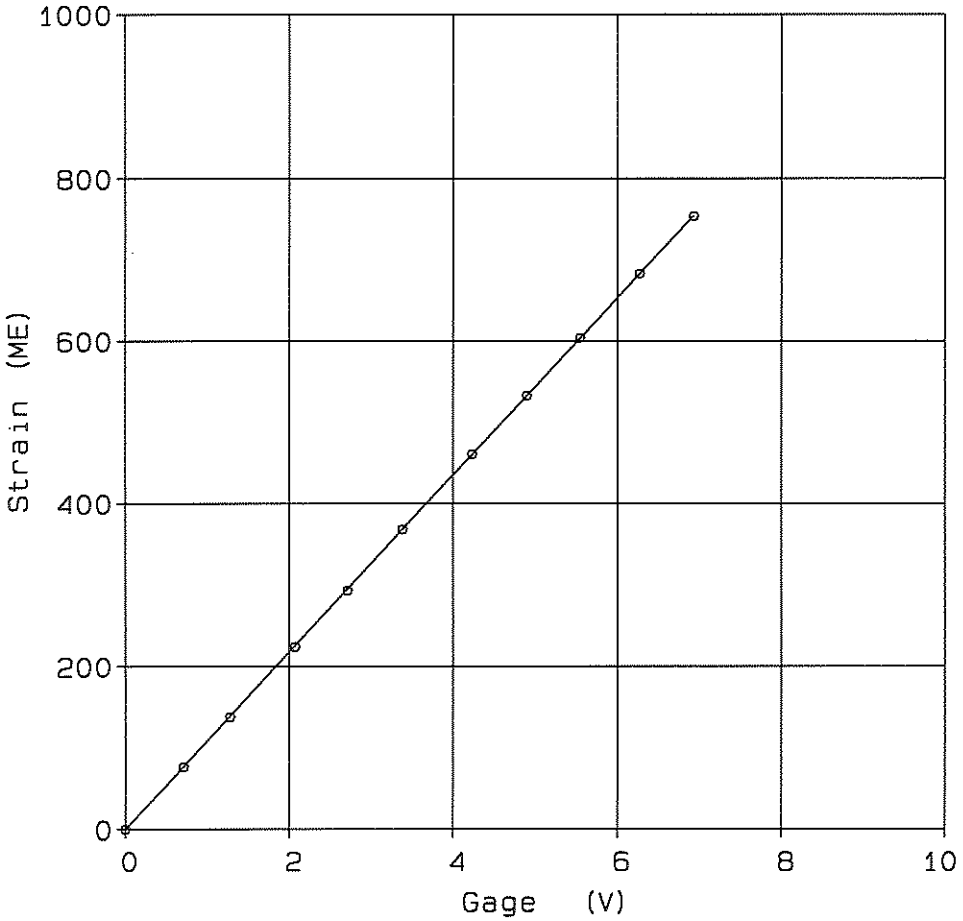

PDA Cal Factor = 109.0 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 378.6 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
78	.72
138	1.29
225	2.07
294	2.71
368	3.39
461	4.24
534	4.90
604	5.55
684	6.28
755	6.93

Calibrated by: _____

Calibrated on: 03-Jul-03

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2