Pile Dynamics Inc
Transducer 512

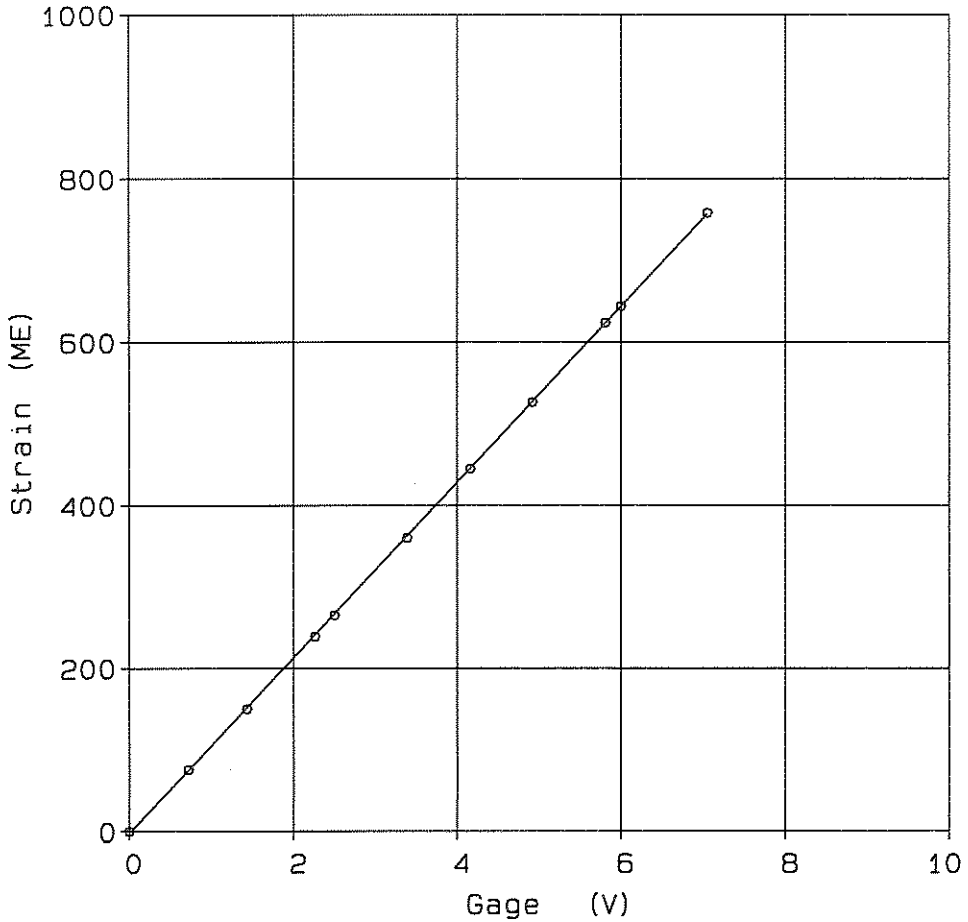

PDA Cal Factor = 107.7 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 374.0 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
76	.73
150	1.43
240	2.26
265	2.51
361	3.39
446	4.17
527	4.93
624	5.82
645	6.01
759	7.06

Calibrated by: J. Dawtchy

Calibrated on: 04-Mar-98

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2