Pile Dynamics, Inc.

Transducer 514

Strain (με)

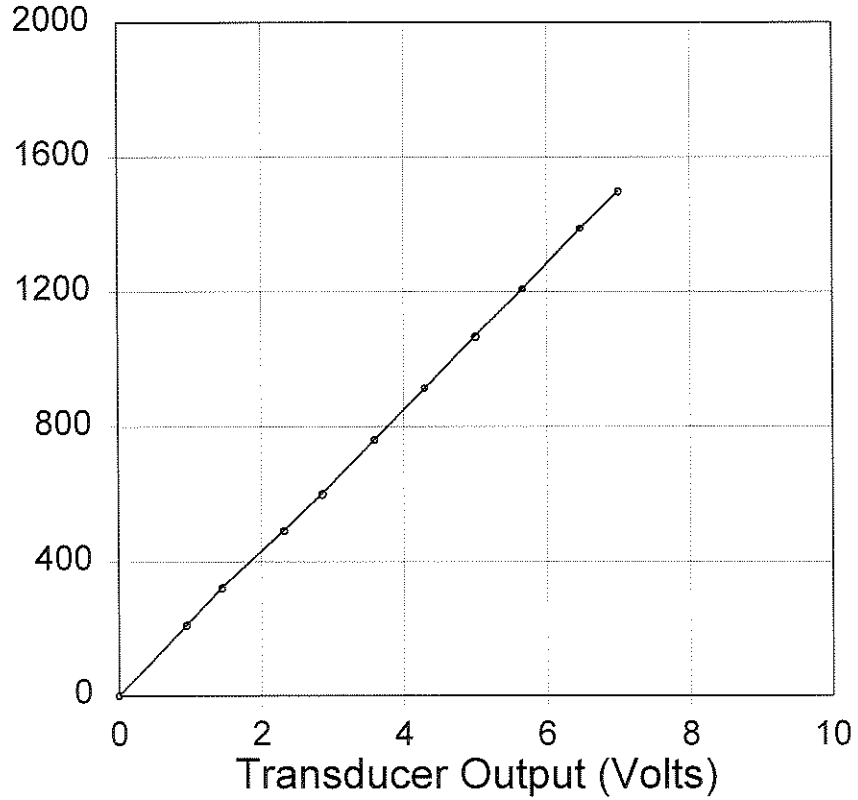

PDA Cal Factor (5.0 V) 106.5με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
212	0.94
320	1.44
490	2.30
598	2.84
761	3.58
912	4.29
1065	5.00
1206	5.65
1385	6.46
1499	7.00

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 369.9με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: Fred Hamm

Calibrated on: 23-Sep-2006

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2