Pile Dynamics Inc
Transducer 516

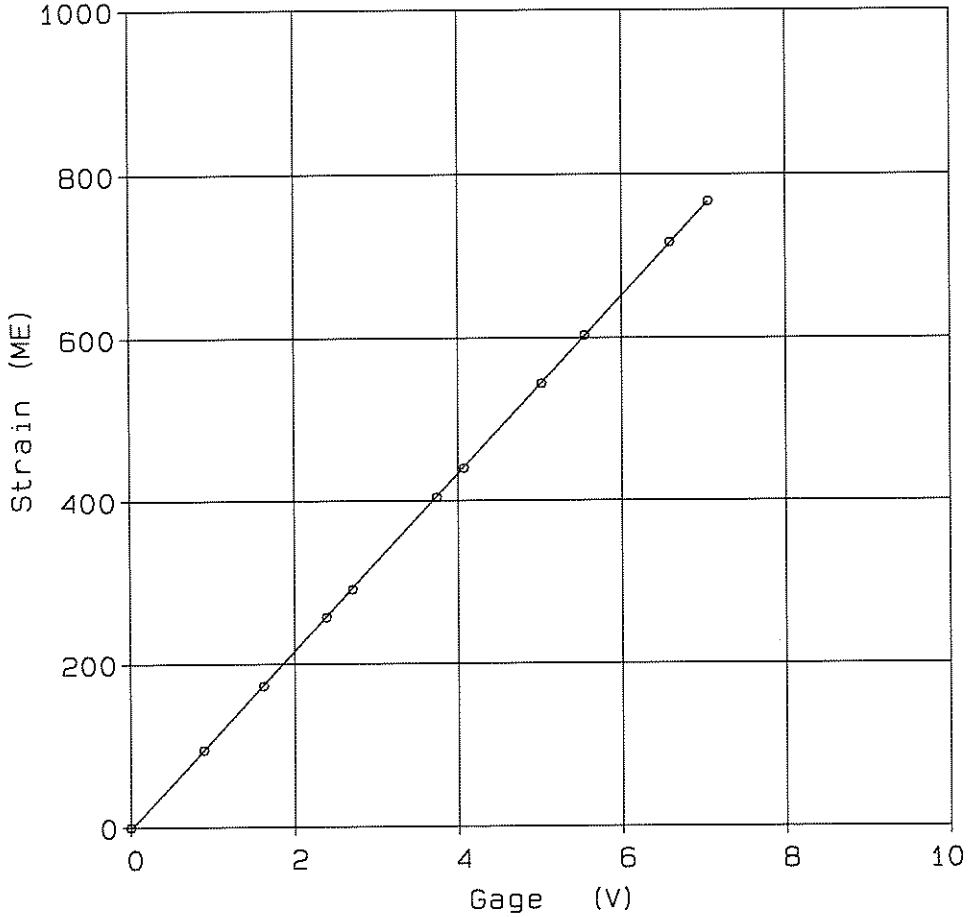

PDA Cal Factor = 109.0 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 378.3 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
95	.90
174	1.63
258	2.40
292	2.72
405	3.75
440	4.08
545	5.02
603	5.55
718	6.60
768	7.07

Calibrated by: J. Davis

Calibrated on: 08-Jun-98

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2