Pile Dynamics Inc
Transducer 518

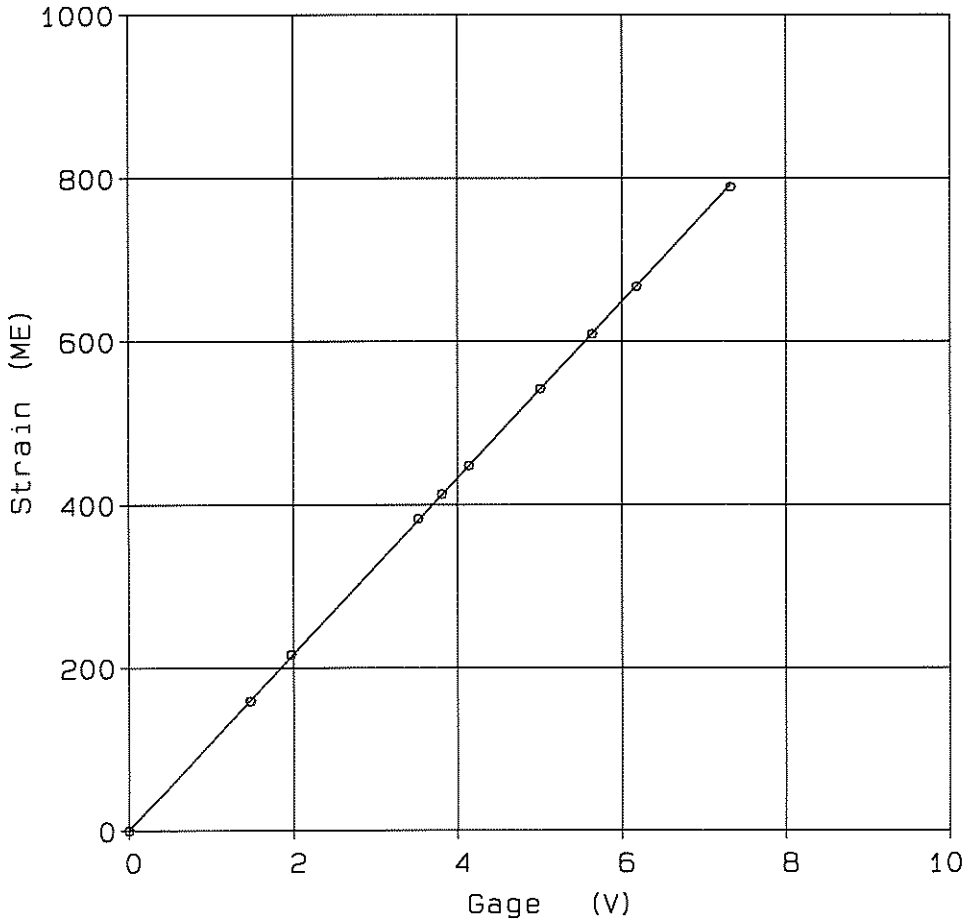

PDA Cal Factor = 107.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 374.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
160	1.48
159	1.48
216	1.98
383	3.53
413	3.81
448	4.14
543	5.01
610	5.64
668	6.19
790	7.34

Calibrated by: J. Deutsch

Calibrated on: 14-Sep-99

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2