Pile Dynamics, Inc.
Transducer 519

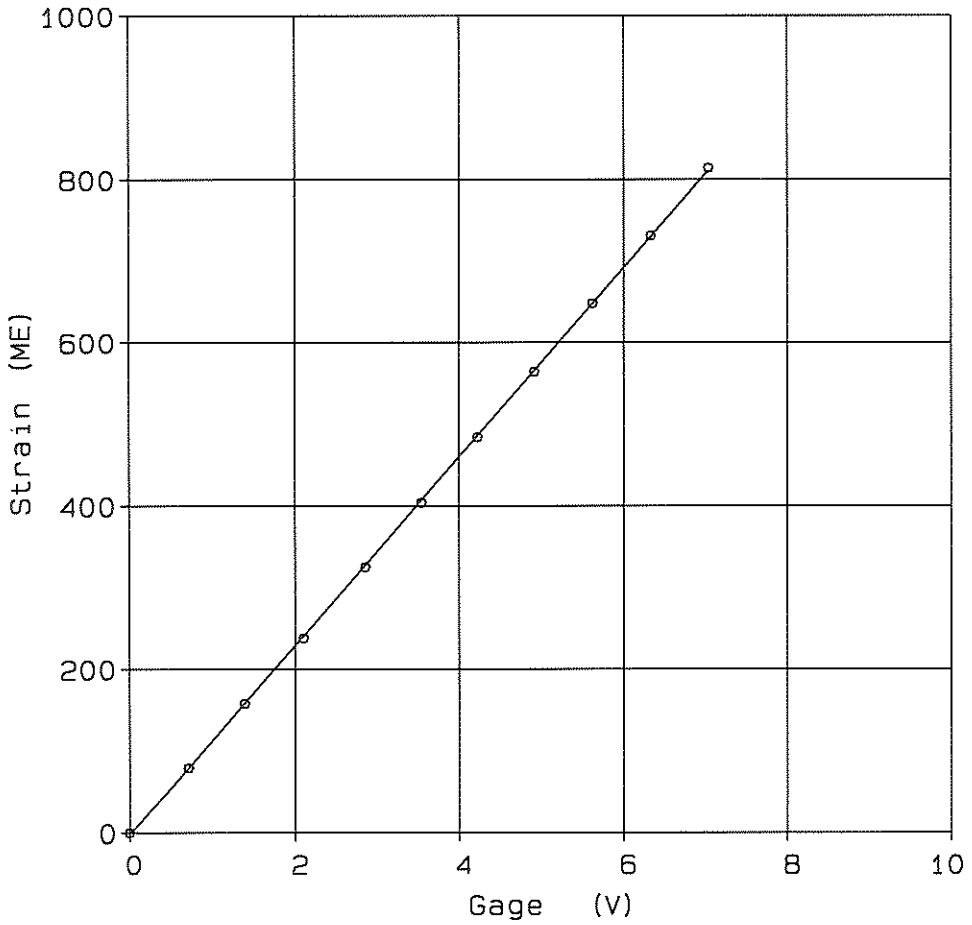

PDA Cal Factor = 115.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 402.3 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
81	.72
158	1.40
239	2.10
325	2.85
405	3.54
484	4.22
565	4.91
649	5.63
732	6.34
815	7.04

Calibrated by:

Calibrated on: 14-Mar-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2