Pile Dynamics, Inc.

Transducer 521

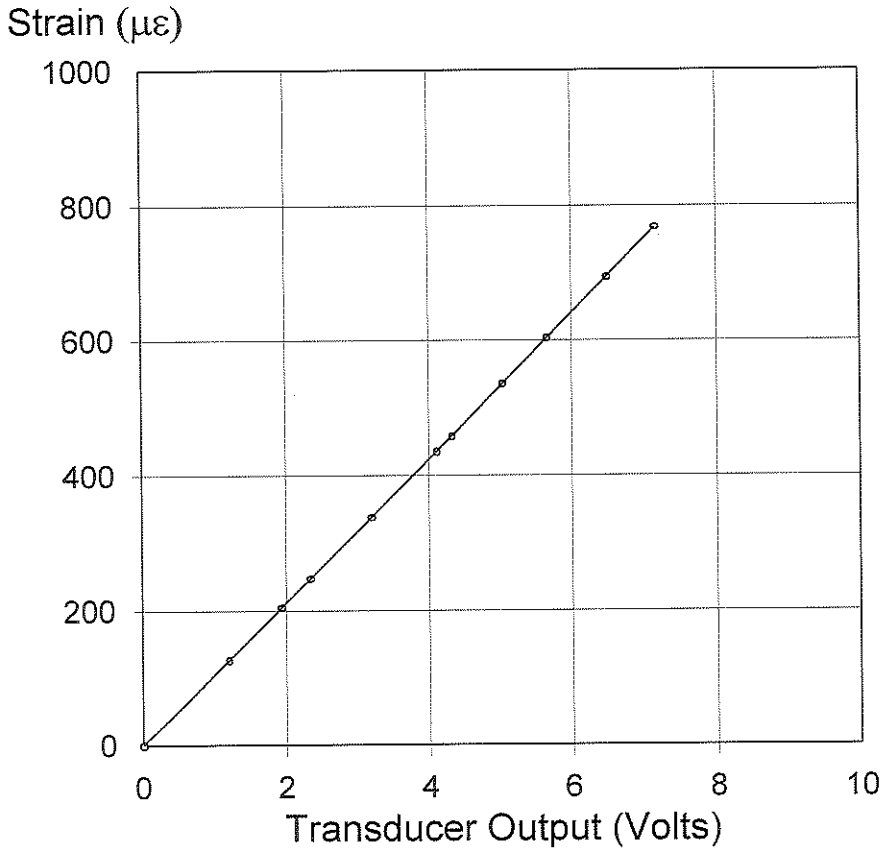

PDA Cal Factor 107.3με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
127	1.20
204	1.93
246	2.33
337	3.19
436	4.11
459	4.32
536	5.03
604	5.65
695	6.49
767	7.15

Shunt (60.4 KΩ) 5.0 V

General Factor 372.7με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: J. Dowdy

Calibrated on: 30-Sep-2004

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2