Pile Dynamics Inc
Transducer 522

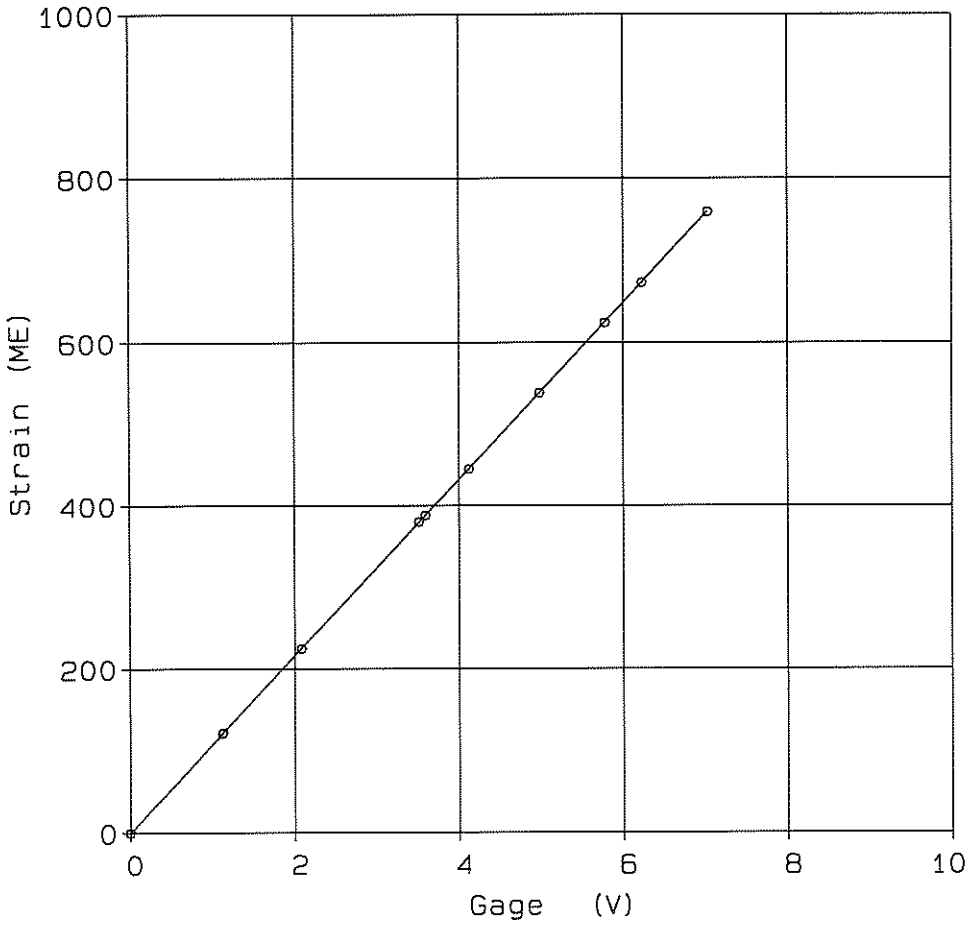

PDA Cal Factor = 108.0 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 375.0 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
123	1.14
121	1.13
225	2.08
381	3.52
389	3.59
445	4.12
538	4.98
625	5.78
674	6.24
759	7.04

Calibrated by: J. Dowdy

Calibrated on: 26-Oct-99

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2