Pile Dynamics, Inc.
Transducer 524

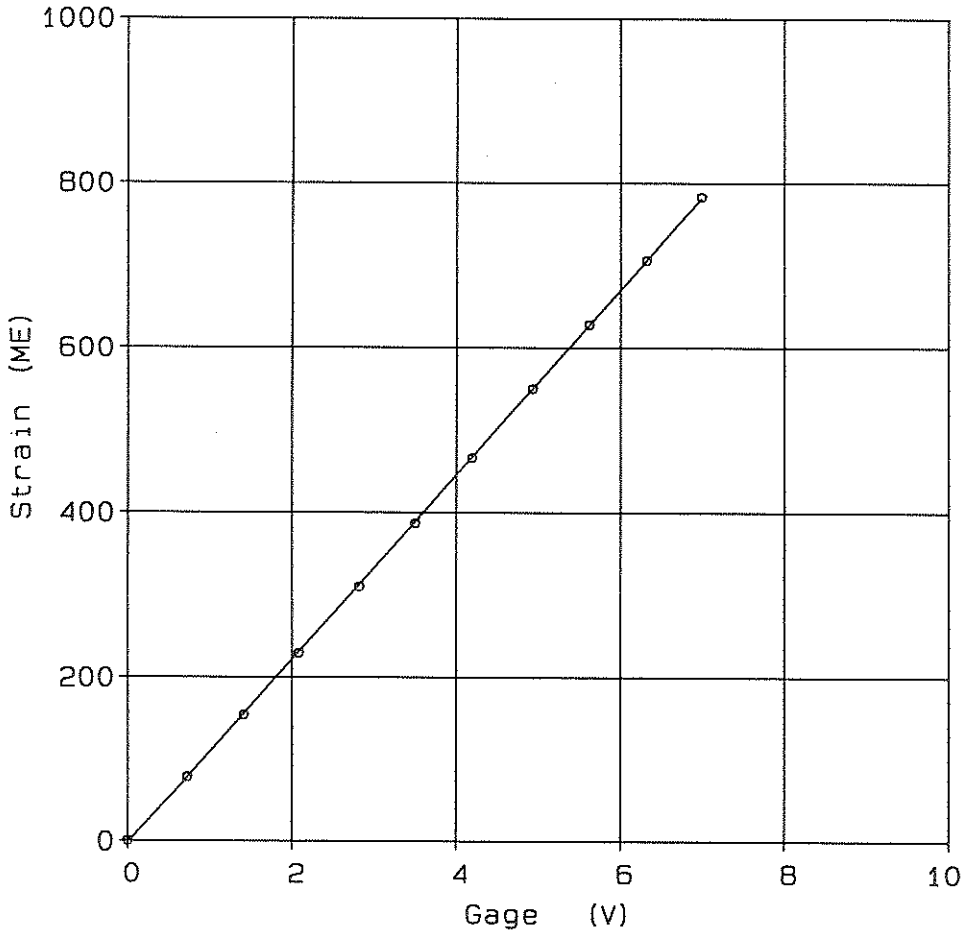

PDA Cal Factor = 112.1 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 389.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
79	.73
155	1.41
230	2.09
310	2.81
388	3.50
466	4.19
551	4.94
628	5.63
707	6.32
784	6.99

Calibrated by: Jason Gorke

Calibrated on: 03-Apr-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2