Pile Dynamics, Inc.
Transducer 525

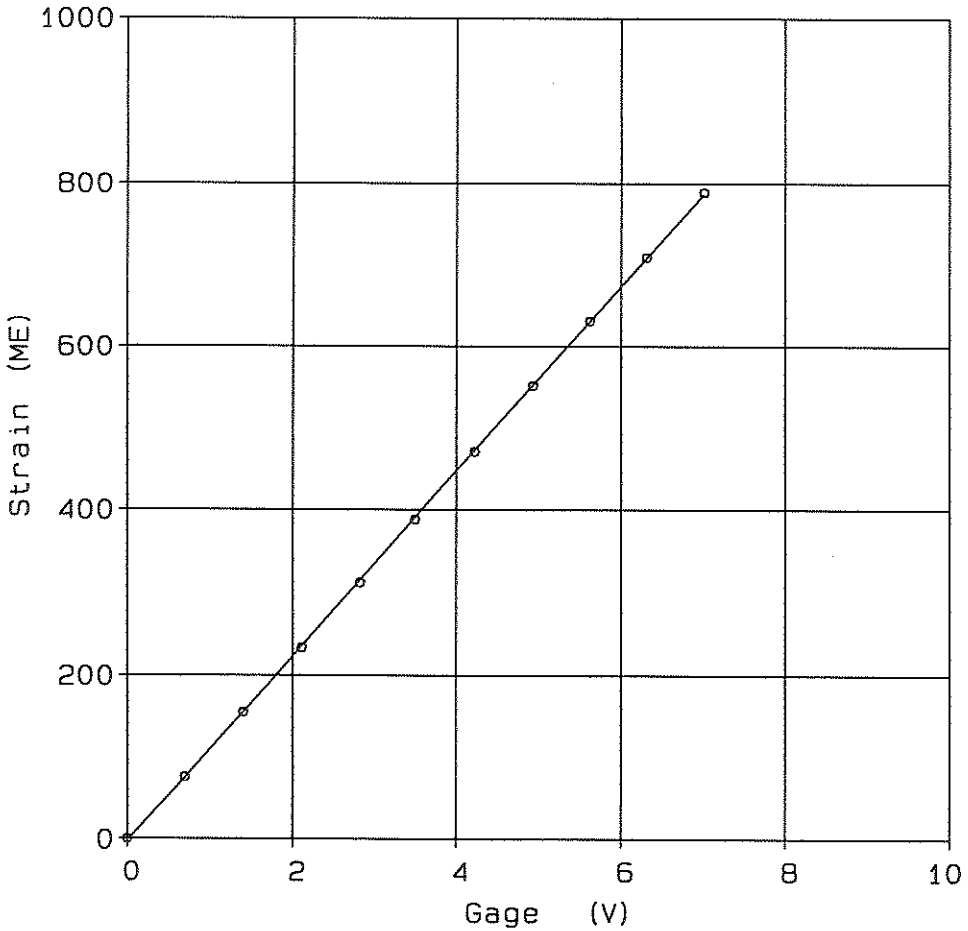

PDA Cal Factor	=	112.6 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	390.9 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
76	.69
156	1.41
234	2.11
313	2.82
389	3.50
471	4.22
552	4.93
631	5.63
710	6.32
789	7.02

Calibrated by: _____

Calibrated on: 03-Apr-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2