Pile Dynamics, Inc.
Transducer 526

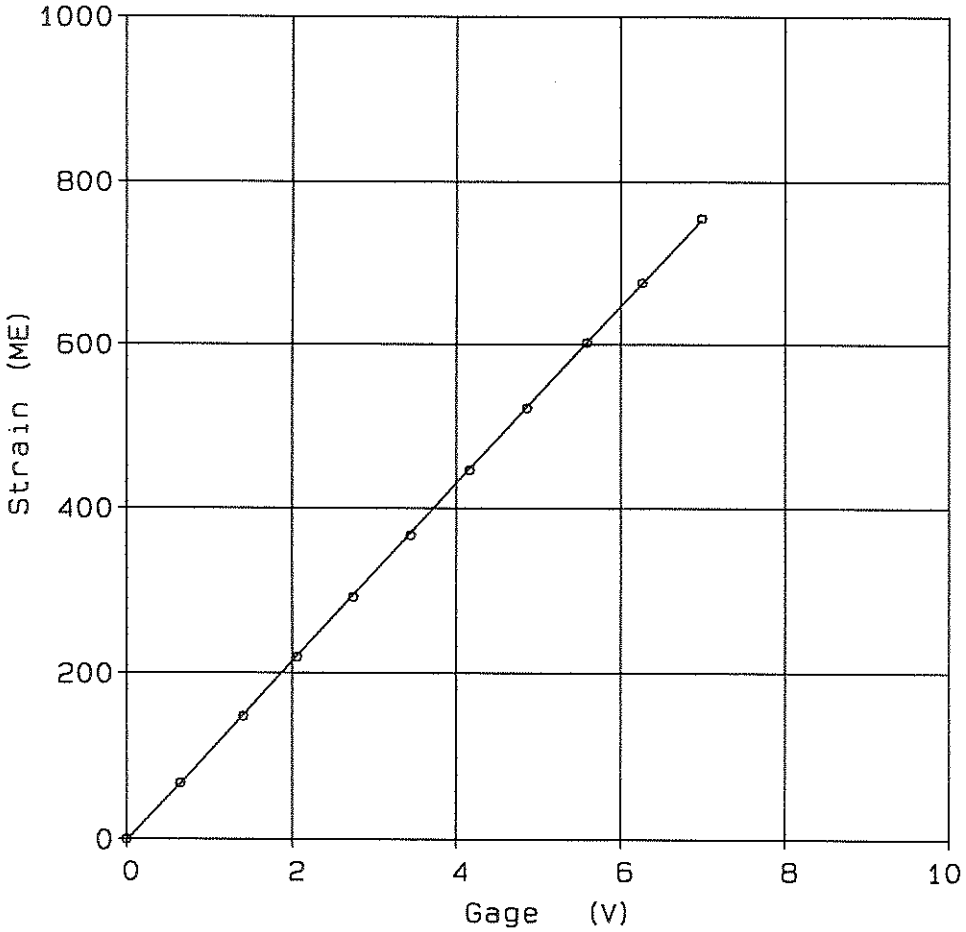

PDA Cal Factor = 108.3 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 375.9 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
68	.65
148	1.40
219	2.07
292	2.75
368	3.44
446	4.17
523	4.86
602	5.59
676	6.26
756	6.99

Calibrated by: _____

Calibrated on: 03-Apr-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2