Pile Dynamics, Inc.

Transducer 528

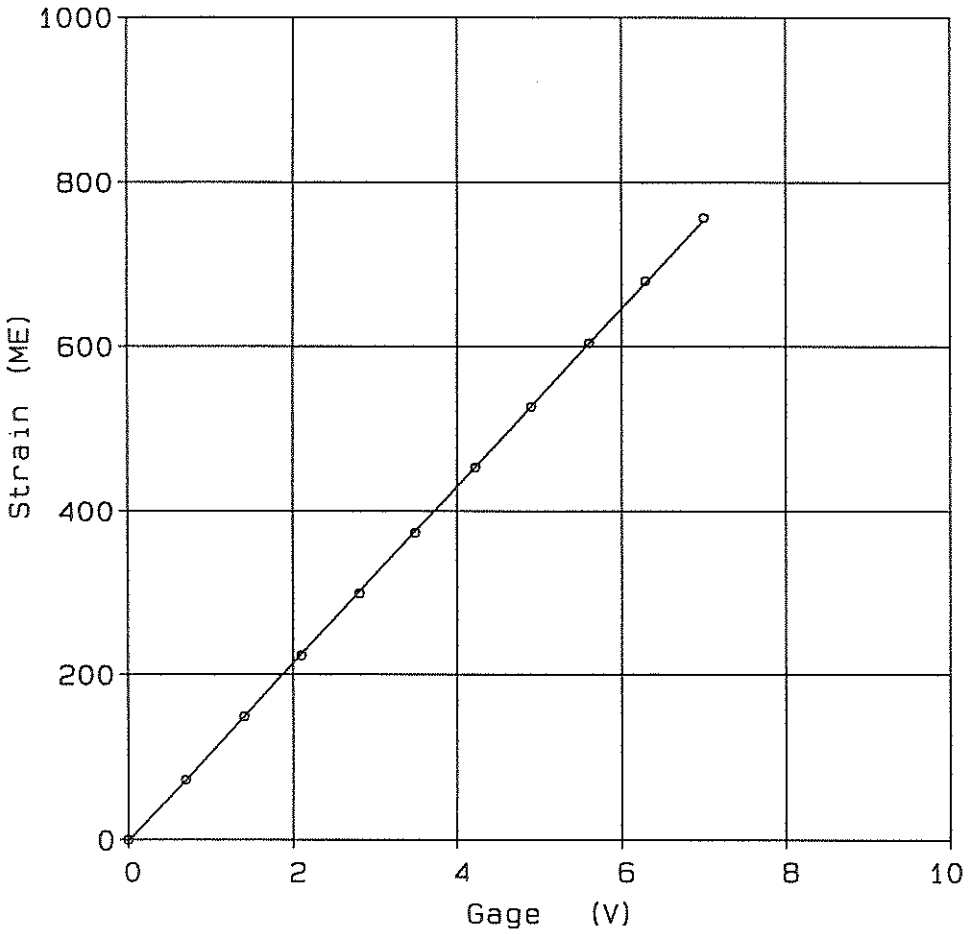

PDA Cal Factor = 108.2 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 375.7 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
74	.70
149	1.40
224	2.11
300	2.81
374	3.50
453	4.23
528	4.91
605	5.61
680	6.30
757	7.00

Calibrated by: Jason Bork

Calibrated on: 03-Apr-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2