Pile Dynamics, Inc.

Transducer 530

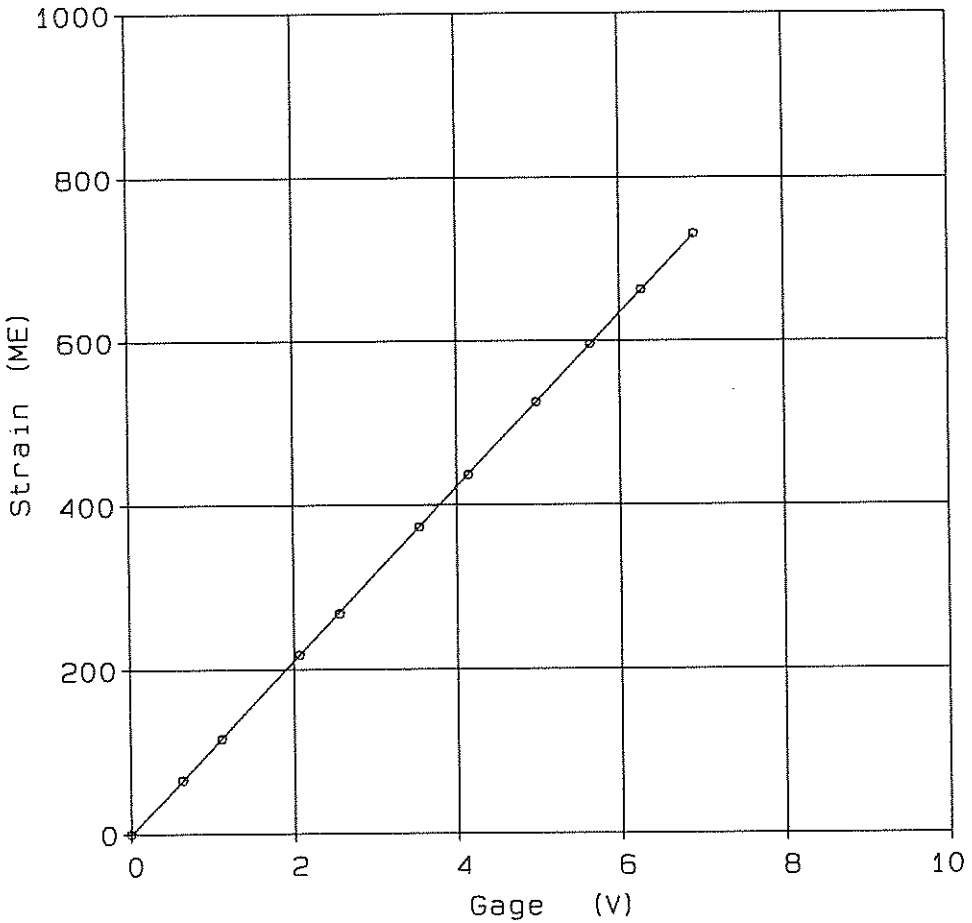

PDA Cal Factor	=	105.9 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	367.6 ME/mV/V

Strain ME	Gage V
0	.00
66	.63
116	1.11
218	2.08
269	2.56
373	3.54
437	4.15
526	4.98
596	5.64
663	6.27
731	6.92

Calibrated by: J. Deutschoff

Calibrated on: 13-Jul-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2