Pile Dynamics Inc
Transducer 531

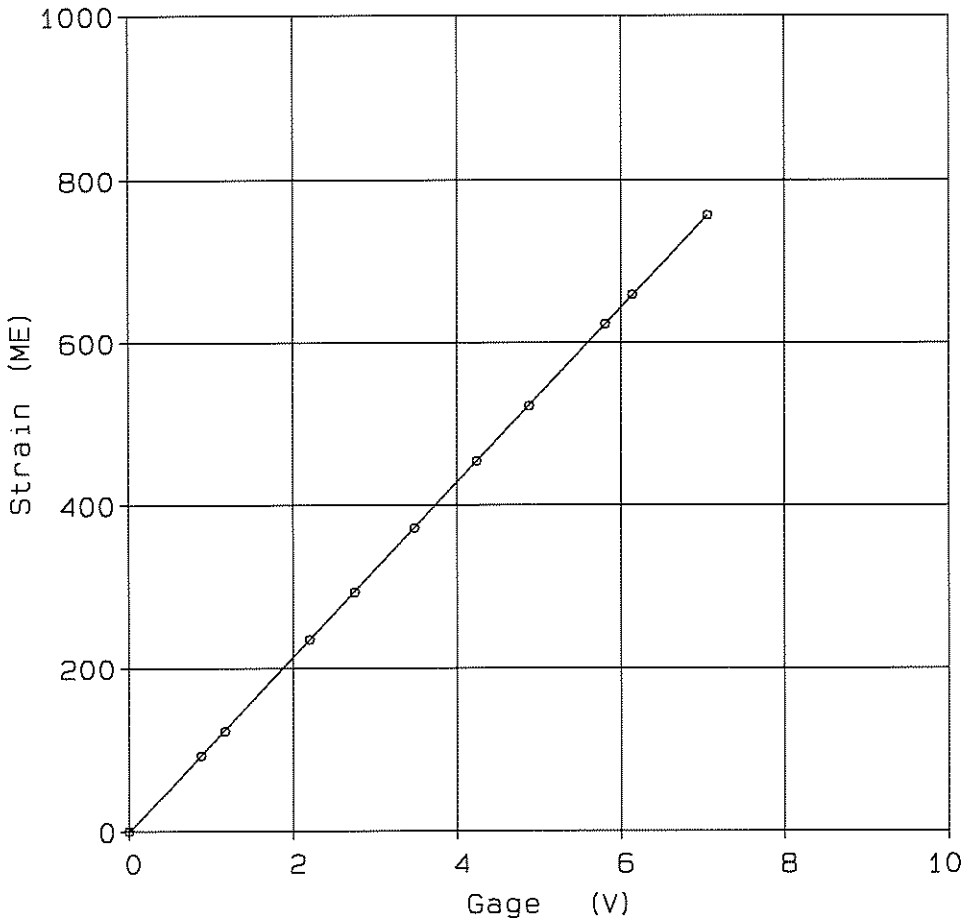

PDA Cal Factor = 107.4 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 373.0 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
94	.88
124	1.17
235	2.21
293	2.76
372	3.49
455	4.25
523	4.88
623	5.81
660	6.15
758	7.06

Calibrated by: J. Barkdoll

Calibrated on: 17-Jul-98

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2