Pile Dynamics, Inc.
Transducer 532

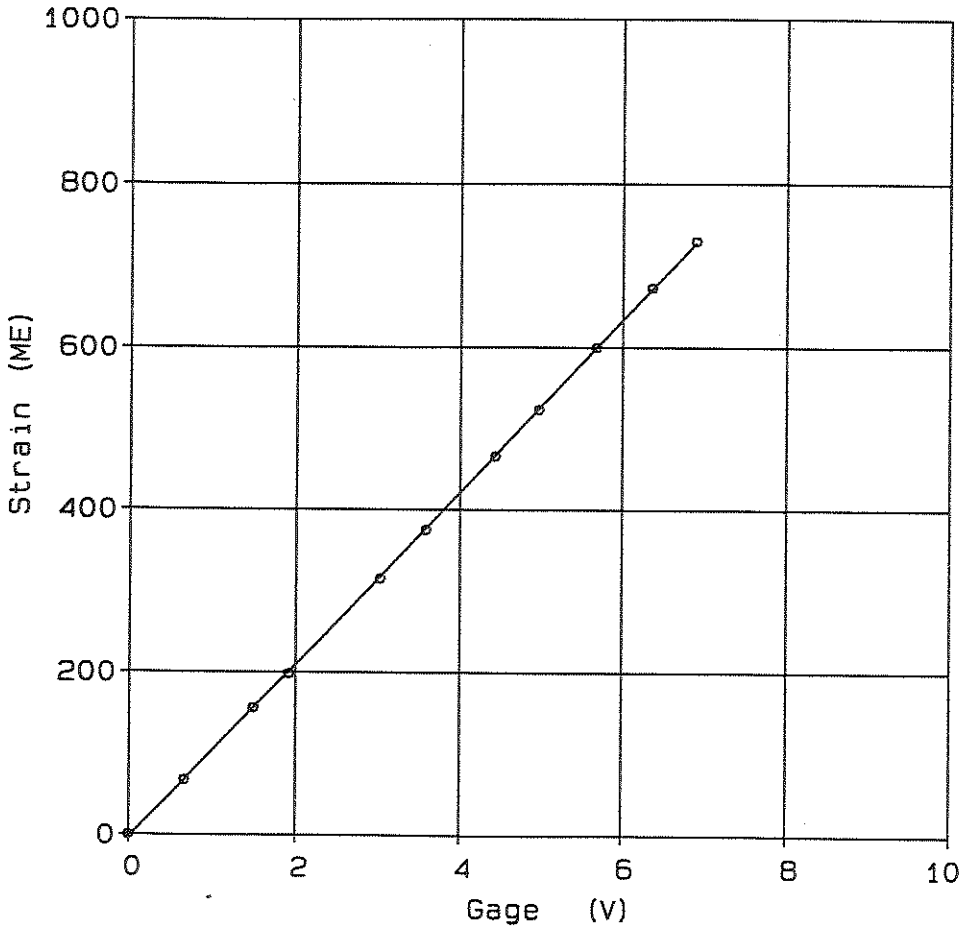

PDA Cal Factor = 106.2 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 368.6 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
69	.67
156	1.51
199	1.92
316	3.03
375	3.59
467	4.44
523	4.97
600	5.68
673	6.36
730	6.89

Calibrated by: J. Deutschoff

Calibrated on: 06-Sep-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2