Pile Dynamics, Inc.
Transducer 533

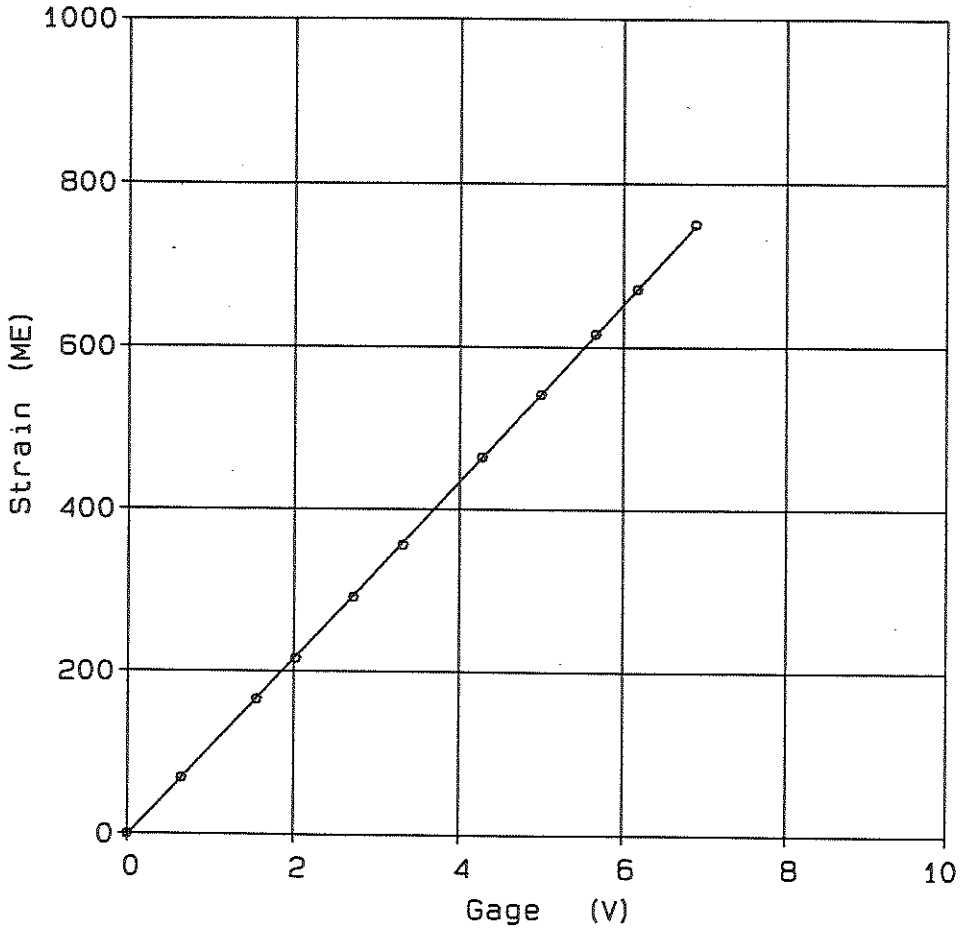

PDA Cal Factor = 109.2 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 379.1 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
69	.65
167	1.56
216	2.03
292	2.71
357	3.31
465	4.28
542	5.00
617	5.67
672	6.18
751	6.88

Calibrated by: _____

Calibrated on: 06-Sep-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2