Pile Dynamics, Inc.

Transducer 534

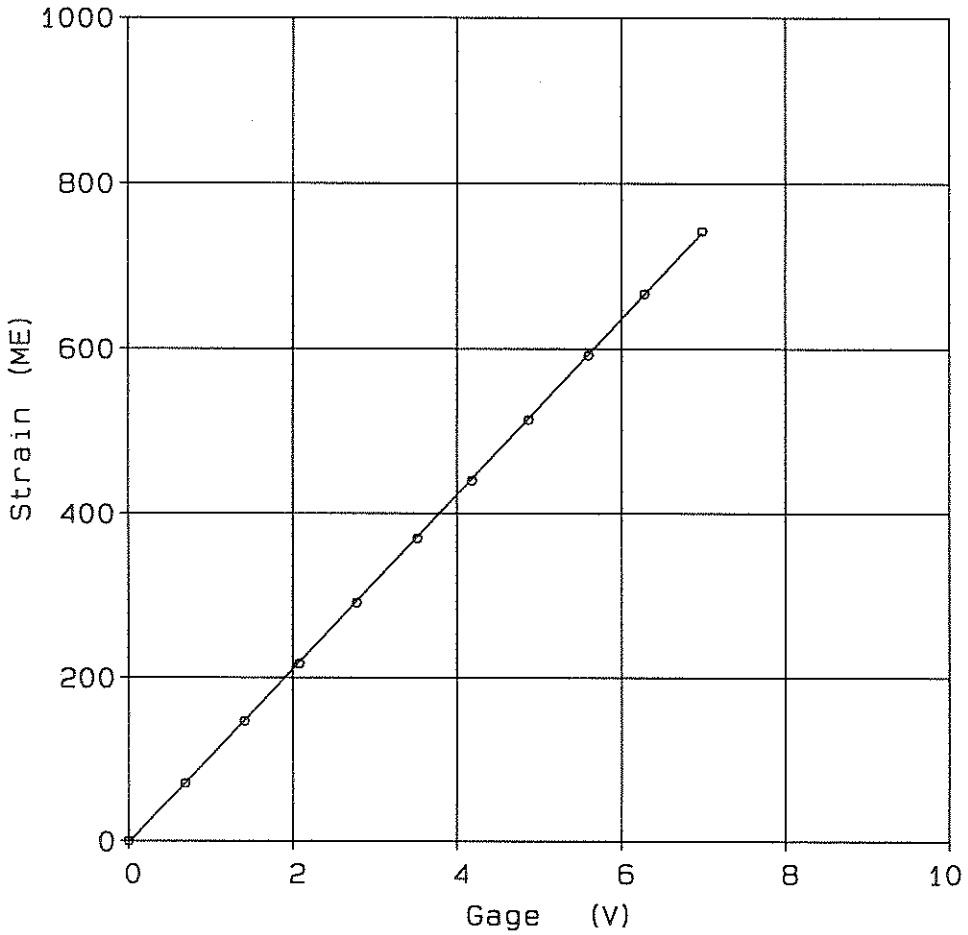

PDA Cal Factor = 106.3 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 369.2 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
72	.69
147	1.42
218	2.09
292	2.79
370	3.53
440	4.18
515	4.87
593	5.60
667	6.29
742	6.99

Calibrated by: _____

Calibrated on: 03-Apr-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2